

MEDVIE


Date du test: 27/08/2025 12:28:27

Durée: 3mn 44s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KONATE OUMAR	
Date de naissance	01/01/2004
Age	21
Société	CR18
ID	25082712251022221

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

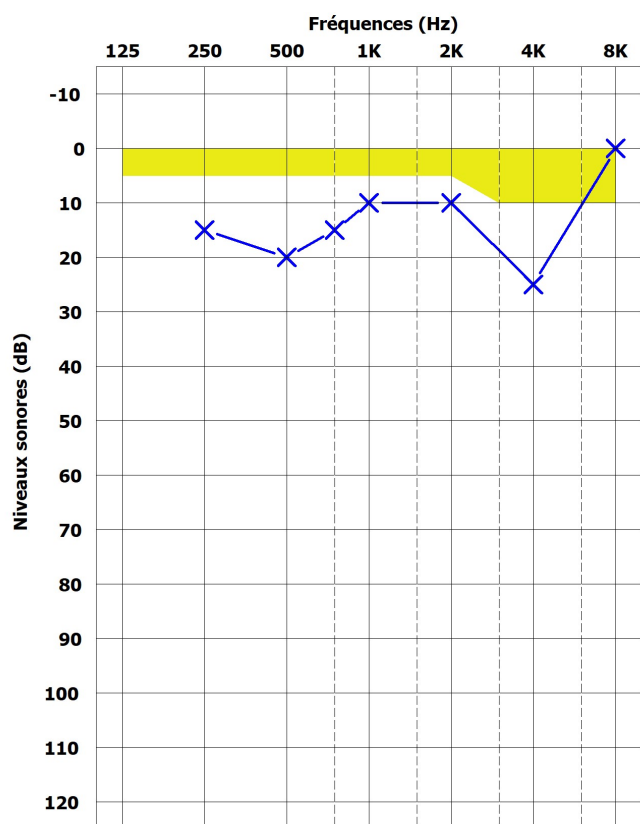

Oreille Gauche

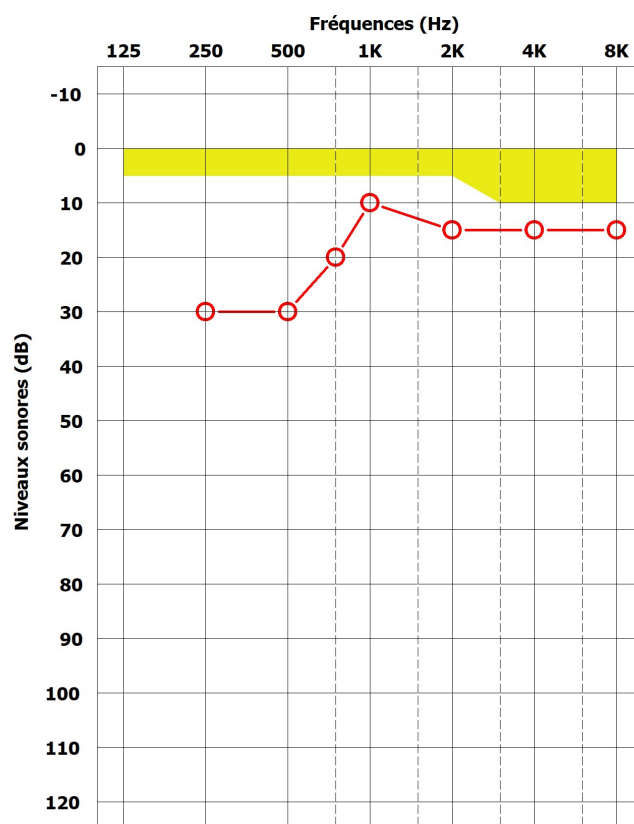

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	10		10		25		0
CA Droit		30	30	20	10		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes