

MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 13:20:15

Durée: 3mn 45s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KEITA FAYA
Date de naissance	20/12/1980
Age	44
Société	CR18
ID	25031313053484988

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

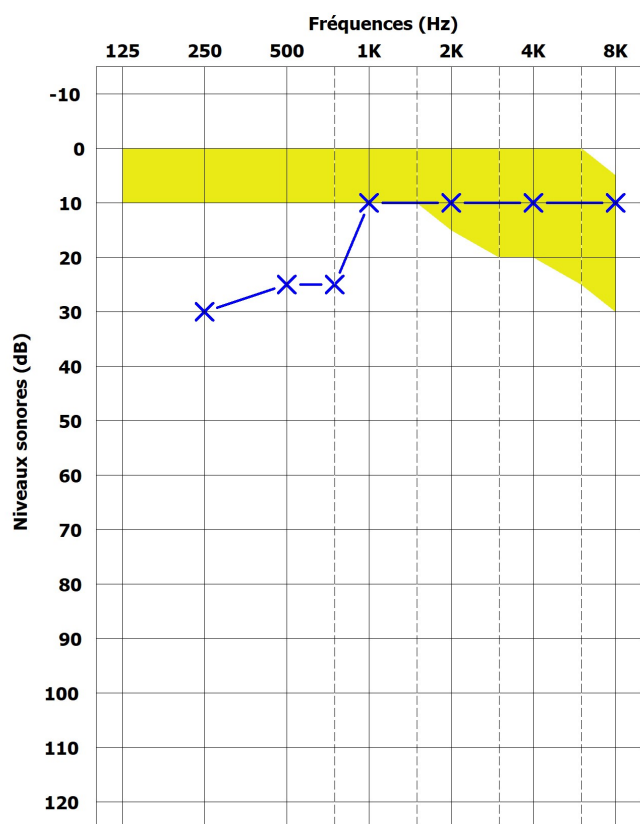

Oreille Gauche

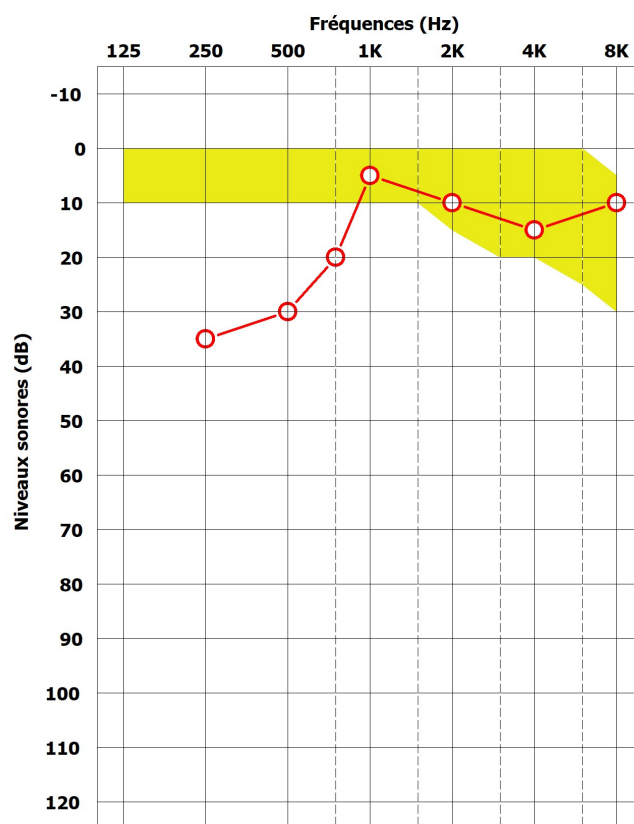

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	10		10		10		10
CA Droit		35	30	20	5		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes