

MEDVIE

Date du test: 17/05/2024 11:27:10

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

KEÏTA SIDIKI

Date de naissance 01/01/1995

Age 29

Société CR18


ID 24051711241778456

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

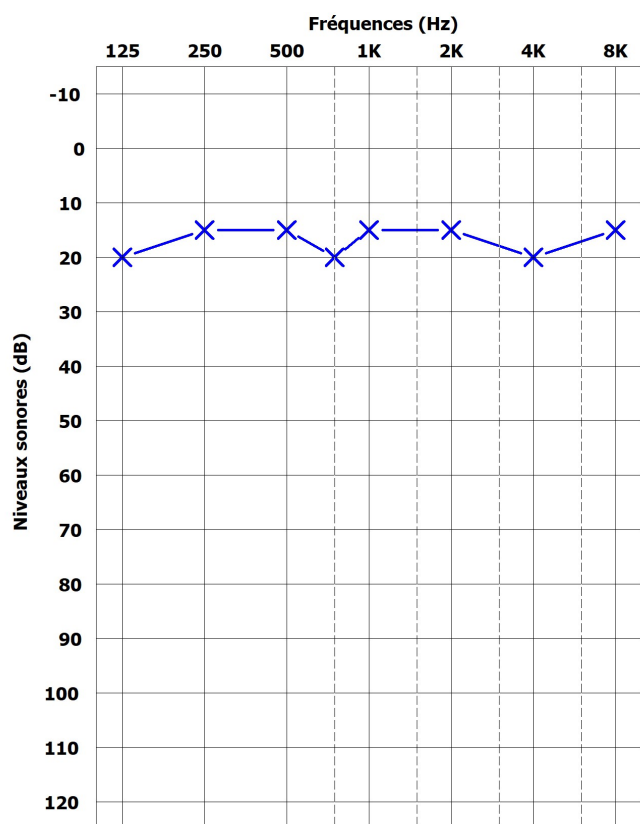

Oreille Gauche

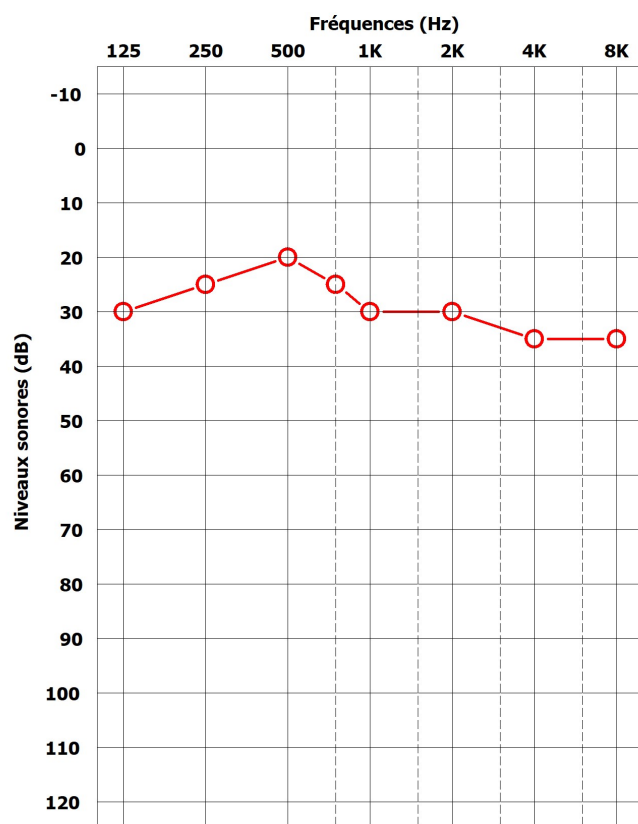

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	20	15		15		20		15
CA Droit	30	25	20	25	30		30		35		35

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes