


MEDVIE


Date du test: 25/08/2025 15:31:14
Durée: 4mn 41s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE KELETY
Date de naissance	17/04/2000	
Age	25	
Société	CR18	
ID	25082515273511725	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

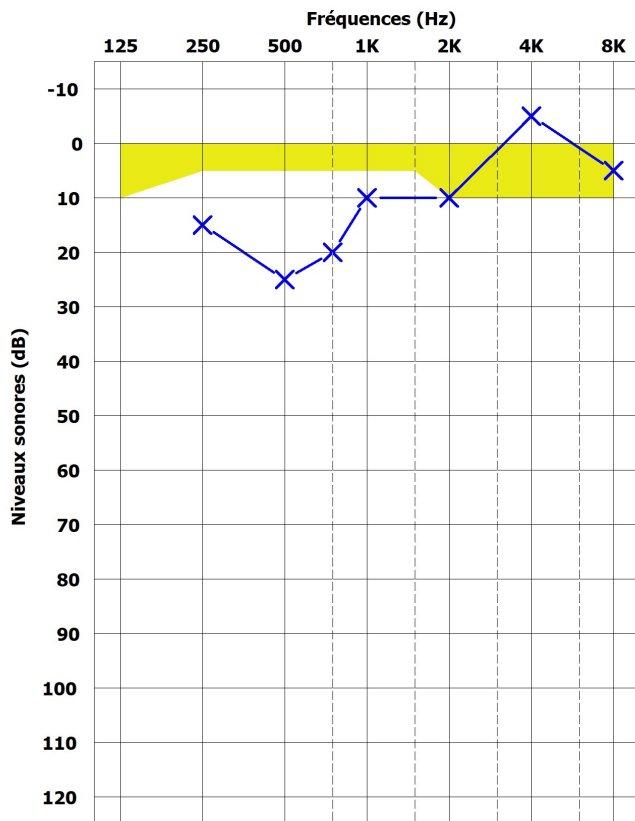

Oreille Gauche

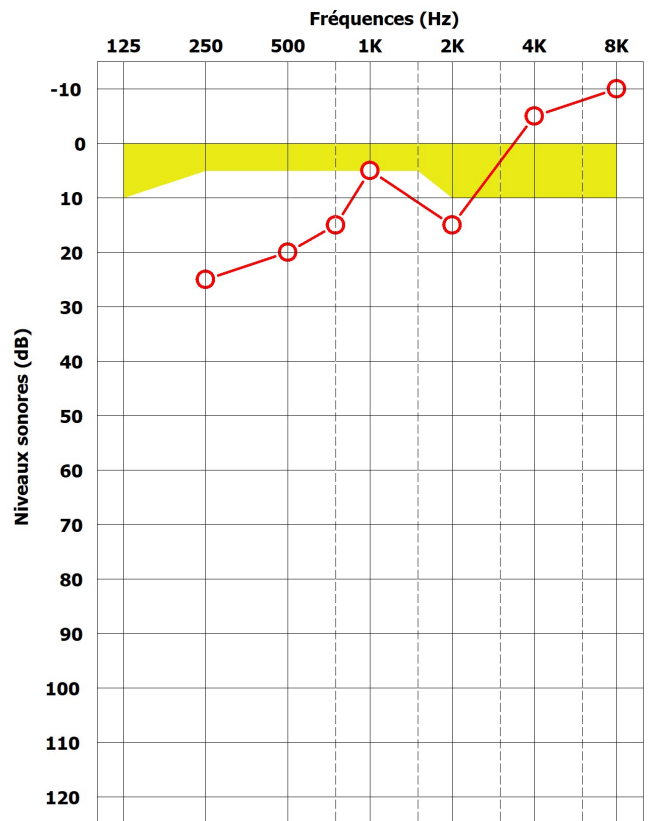

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	20	10		10		-5		5
CA Droit		25	20	15	5		15		-5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes