


MEDVIE


Date du test: 29/07/2025 14:52:02
Durée: 5mn 00s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA KEMOKO	
Date de naissance	01/04/1960
Age	65
Société	CR18
ID	25072914375381746

Audiomètre	
Type:	Audio 800M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

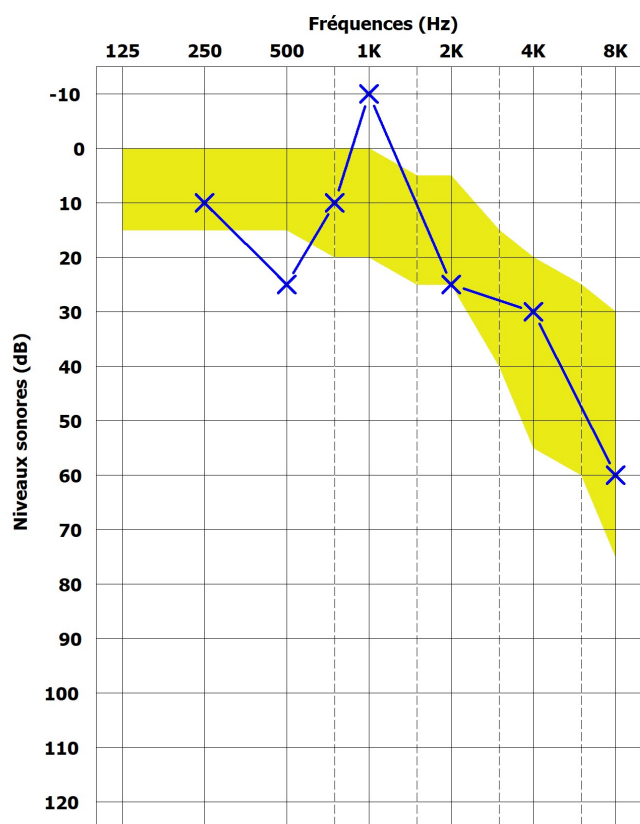

Oreille Gauche

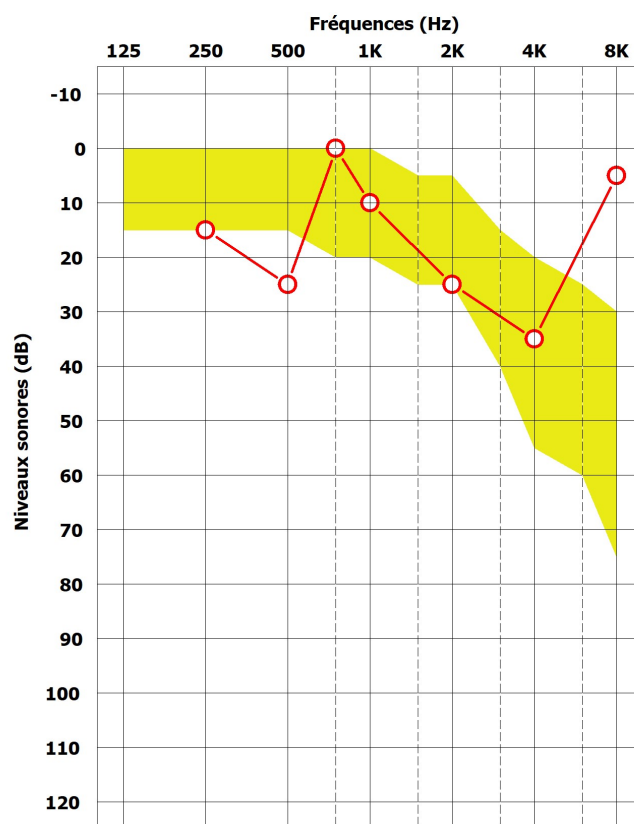

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	10	-10		25		30		60
CA Droit		15	25	0	10		25		35		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes