


MEDVIE


Date du test: 10/04/2025 12:16:41
Durée: 5mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEIRA SIDIKI	
Date de naissance	01/01/1997
Age	28
Société	CR18
ID	25041012052922010

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

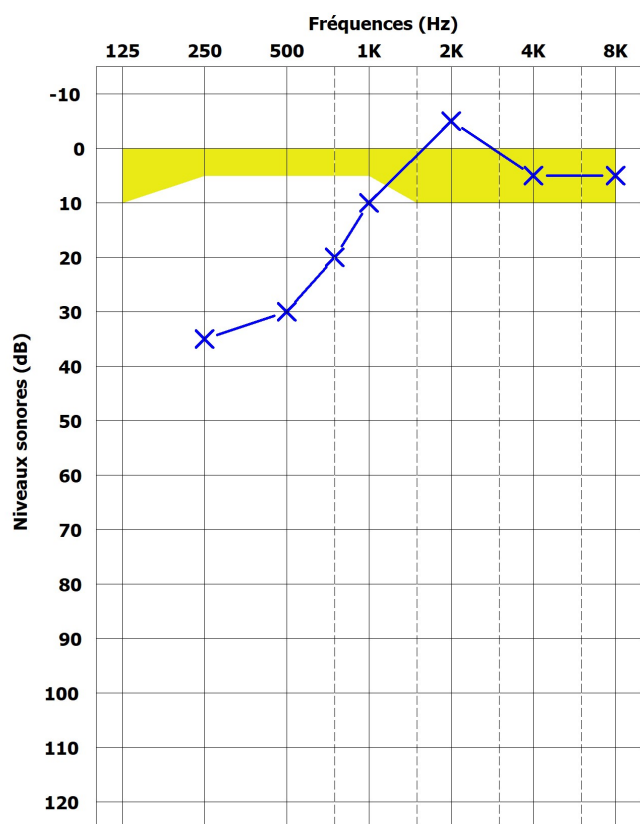

Oreille Gauche

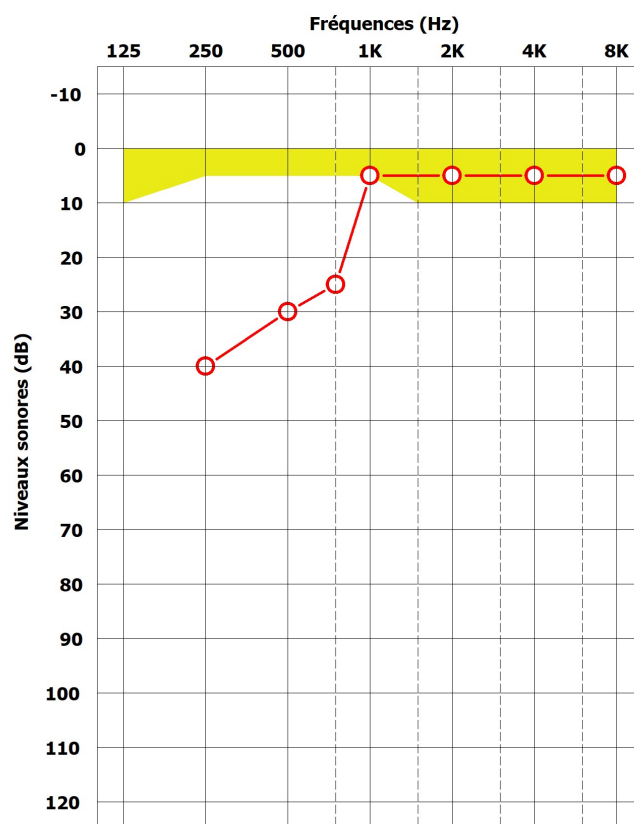

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30	20	10		-5		5		5
CA Droit		40	30	25	5		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes