


MEDVIE


Date du test: 08/08/2025 20:52:41
Durée: 3mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
ZHAO QIGUO	
Date de naissance	19/10/1970
Age	54
Société	CR18
ID	25070416180043839

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

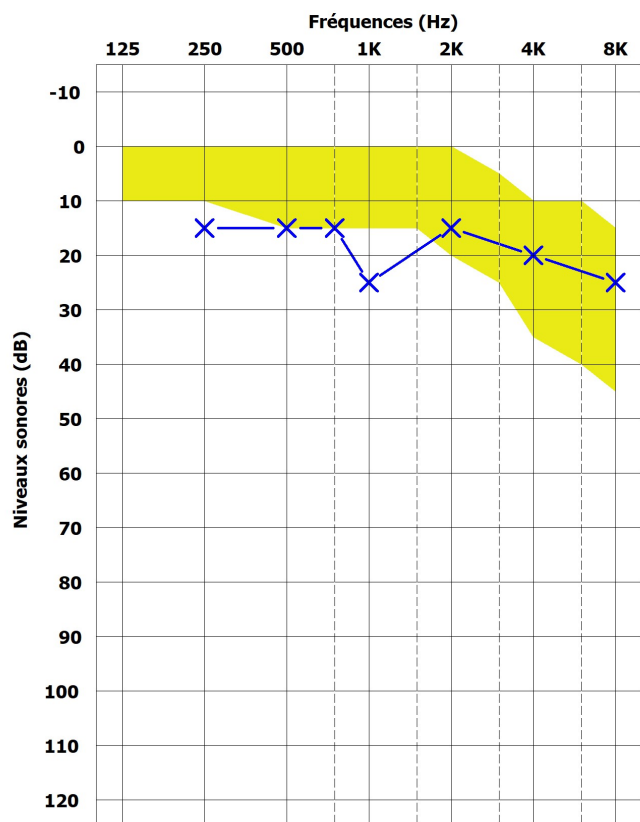

Oreille Gauche

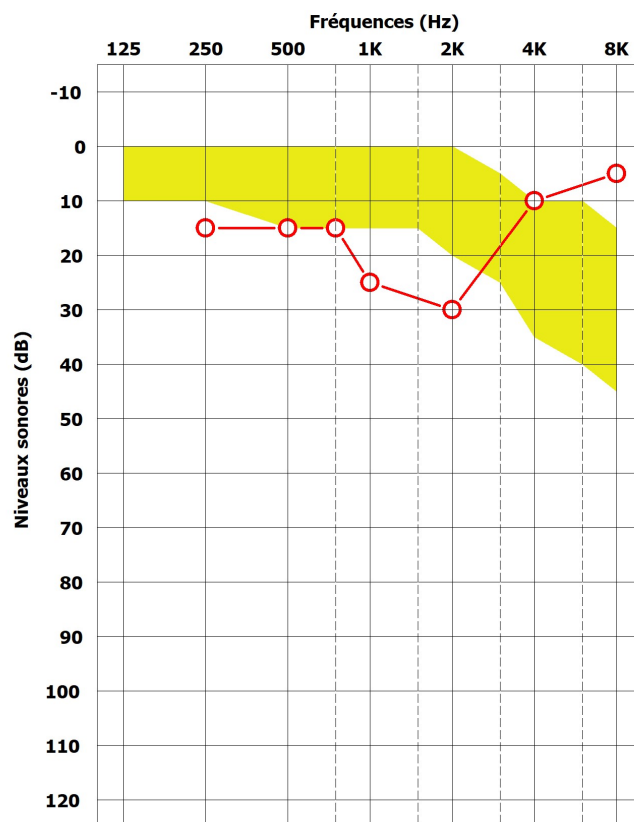

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	25		15		20		25
CA Droit		15	15	15	25		30		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes