

MEDVIE


Date du test: 10/07/2025 17:45:28

Durée: 5mn 15s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIALLO YAKOUBA
Date de naissance	01/01/2003	
Age	22	
Société	CR18	
ID	25071017353989977	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

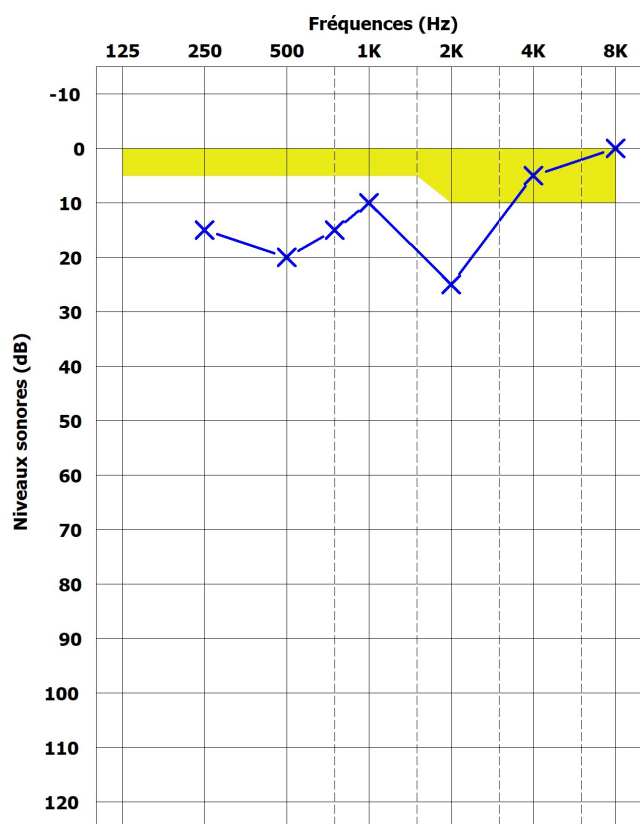

Oreille Gauche

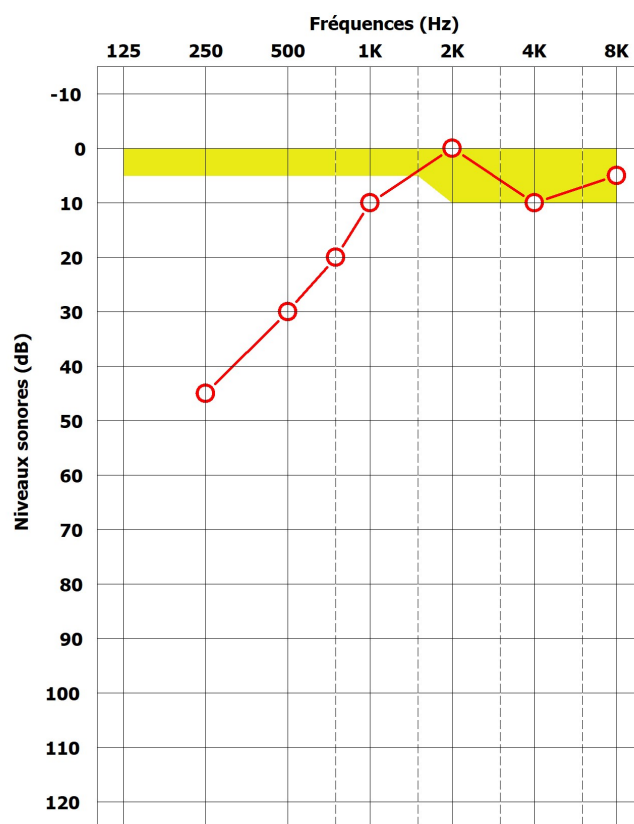

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	10		25		5		0
CA Droit		45	30	20	10		0		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes