

MEDVIE

Date du test: 24/05/2024 10:16:28

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

KABA OUMAR

Date de naissance 01/01/1998

Age 26

Société CR18


ID 24052410115770861

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

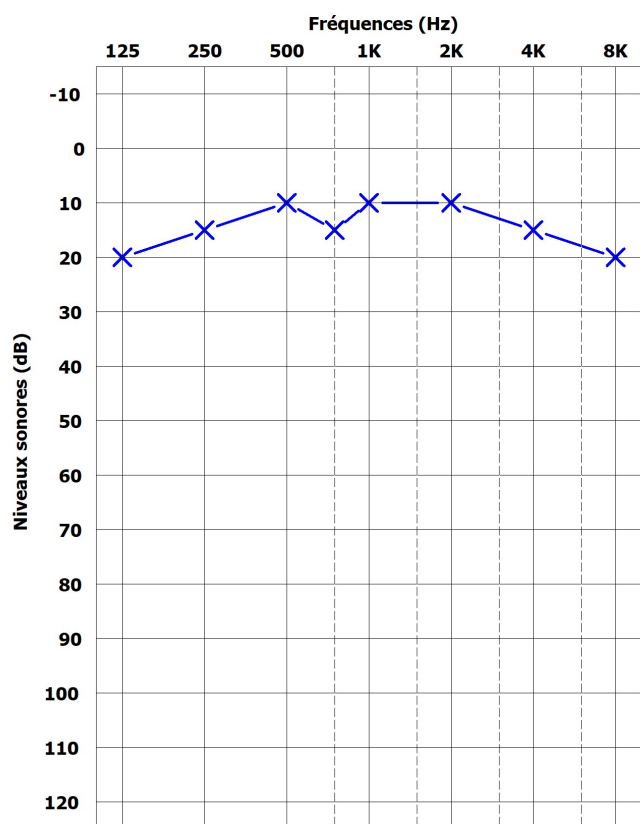

Oreille Gauche

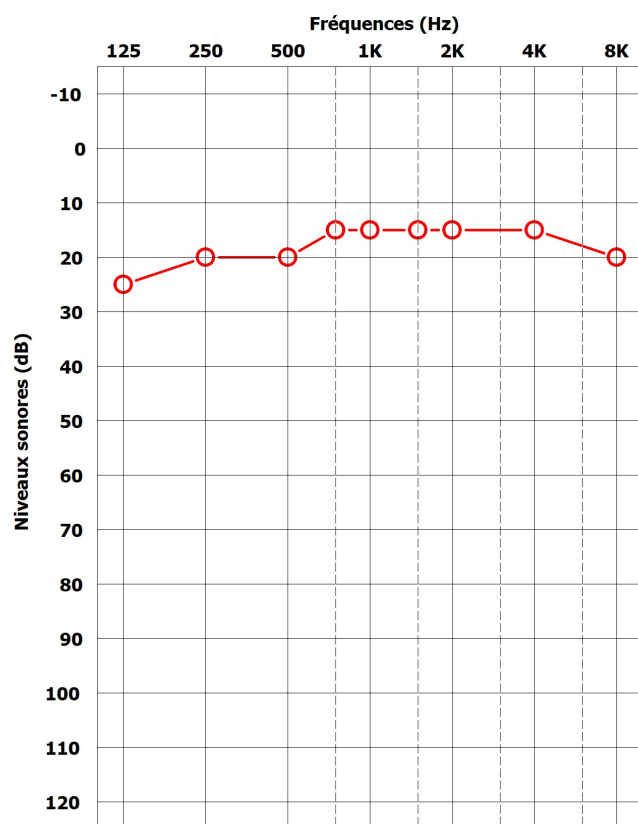

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	10	15	10		10		15		20
CA Droit	25	20	20	15	15	15	15		15		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes