



MEDVIE

Date du test: 14/07/2025 18:40:52
Durée: 4mn 50s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

SIDIBE FODE


Date de naissance 01/01/1996
Age 29
Société CR18
ID 25071418375093359

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

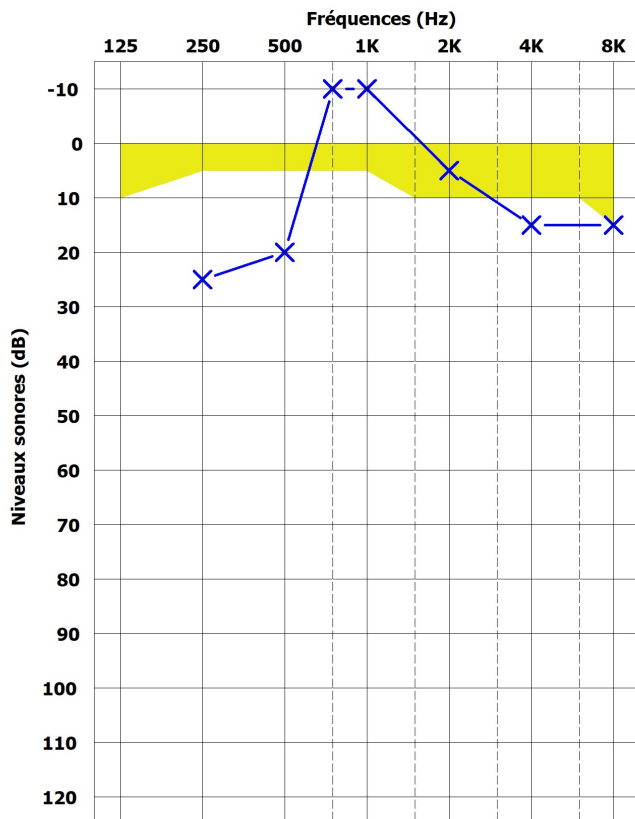

Oreille Gauche

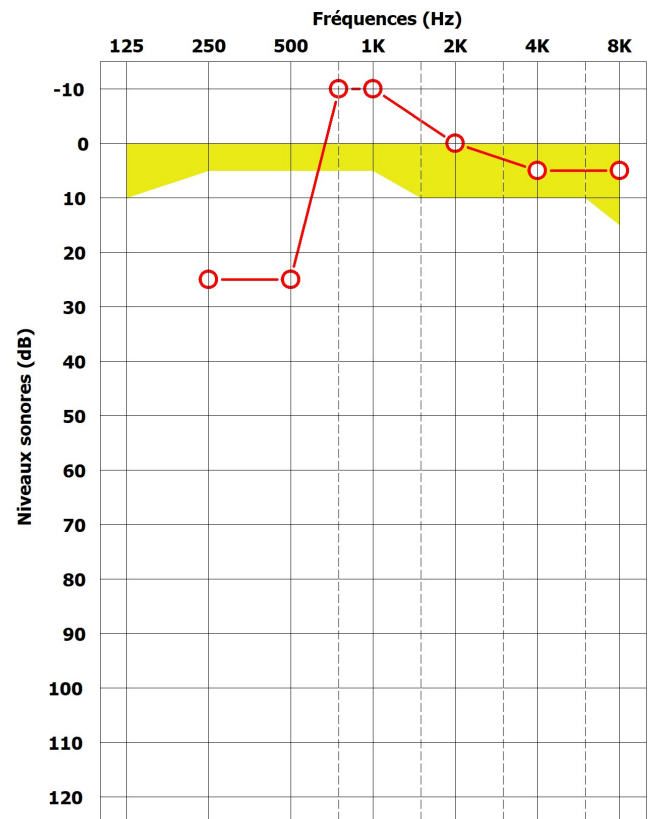

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	-10	-10		5		15		15
CA Droit		25	25	-10	-10		0		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes