


MEDVIE


Date du test: 04/04/2024 14:22:44
Durée: 12mn 18s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO MAMADOU YERO	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24040414195856467

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

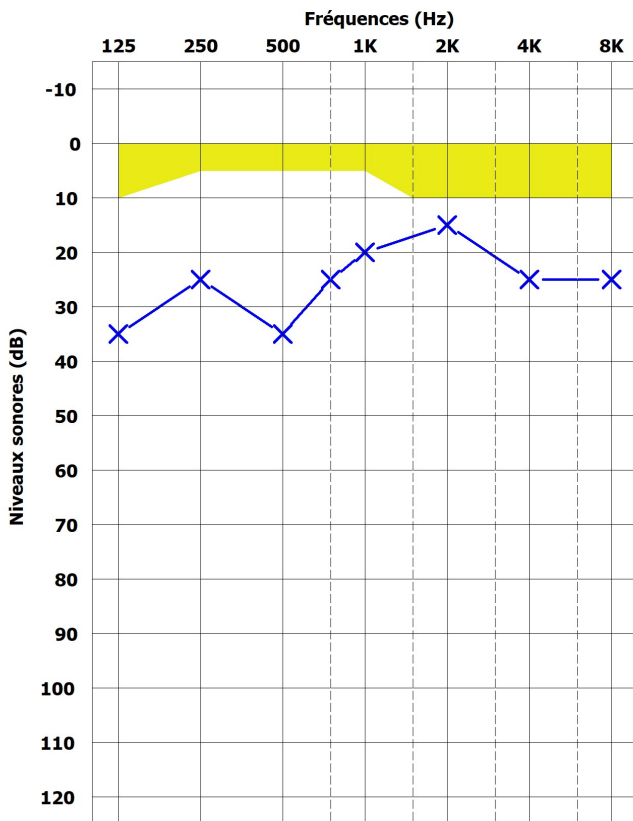

Oreille Gauche

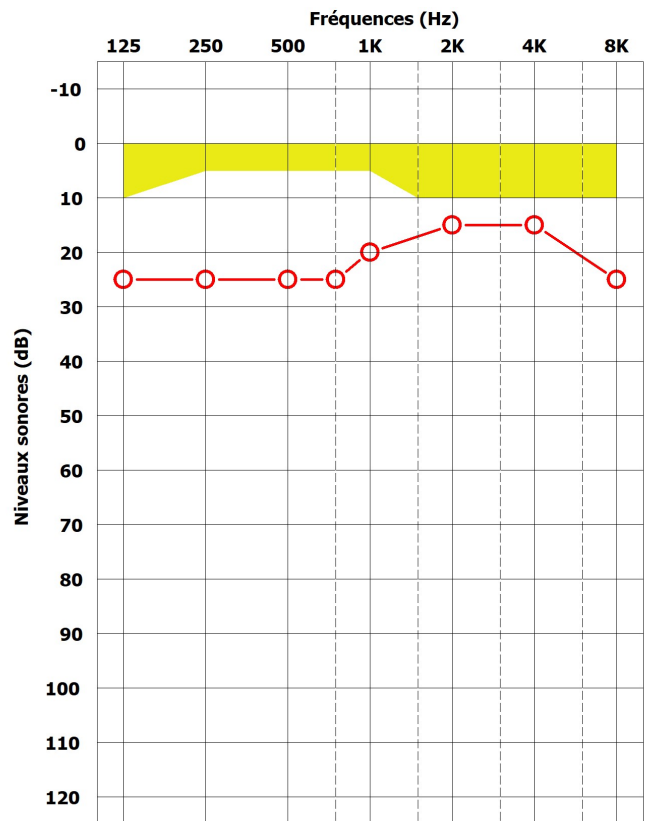

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	25	35	25	20		15		25		25
CA Droit	25	25	25	25	20		15		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes