


MEDVIE


Date du test: 02/06/2024 13:45:29
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	
CISSE SAMOUKA	
Date de naissance	05/06/2002
Age	21
Société	CR18
ID	24060213441507064

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

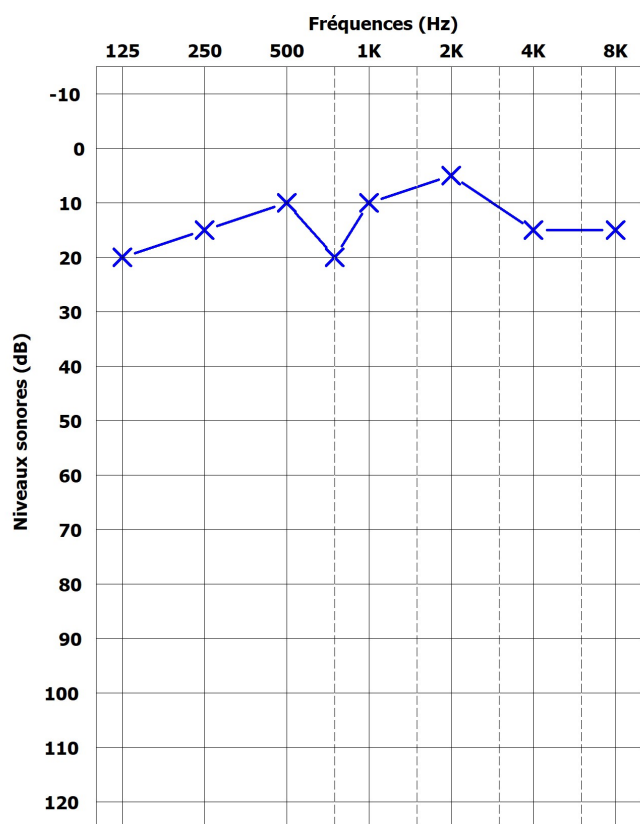

Oreille Gauche

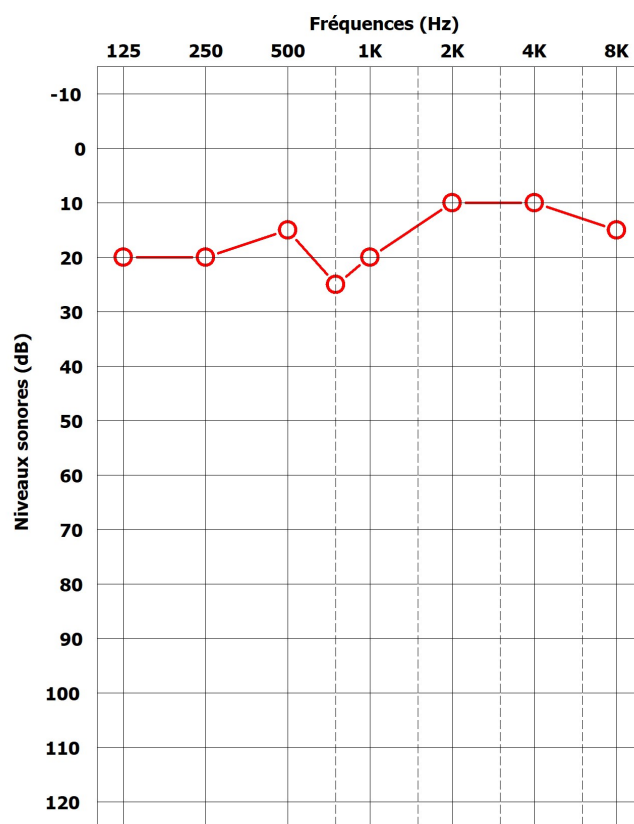

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	10	20	10		5		15		15
CA Droit	20	20	15	25	20		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes