

MEDVIE

Date du test: 31/05/2024 13:27:33


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel


Continu

Données Patient	KONATE ABOU
Date de naissance	01/01/1985
Age	39
Société	CR18
ID	24053112012857364

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

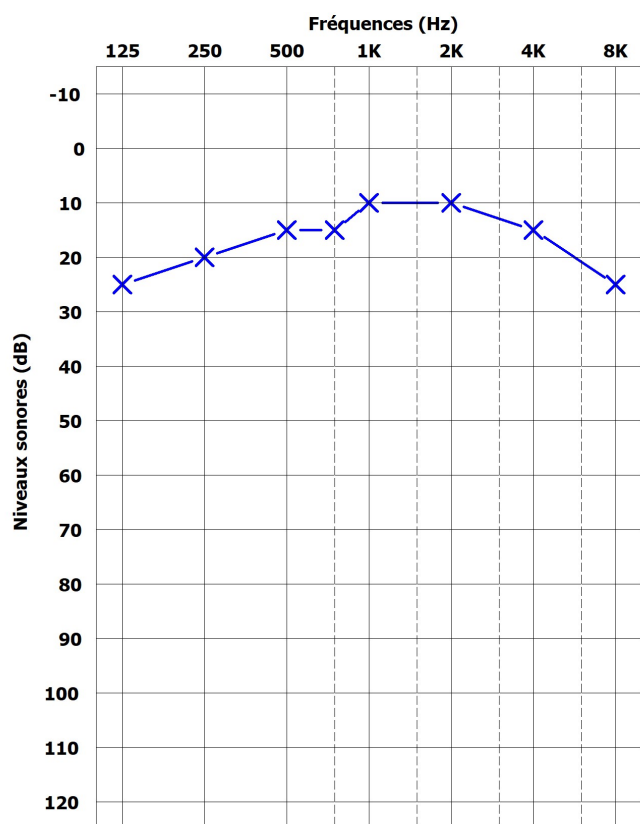

Oreille Gauche

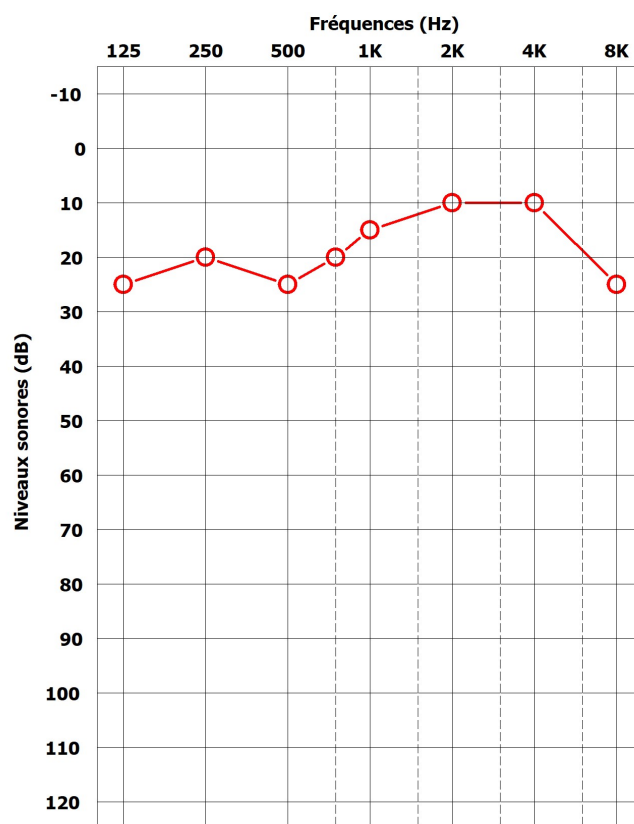

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	15	15	10		10		15		25
CA Droit	25	20	25	20	15		10		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes