


MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 15:25:09
Durée: 3mn 23s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		BALDE SADOU
Date de naissance	12/12/1999	
Age	24	
Société	CR18	
ID	24100115164461109	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

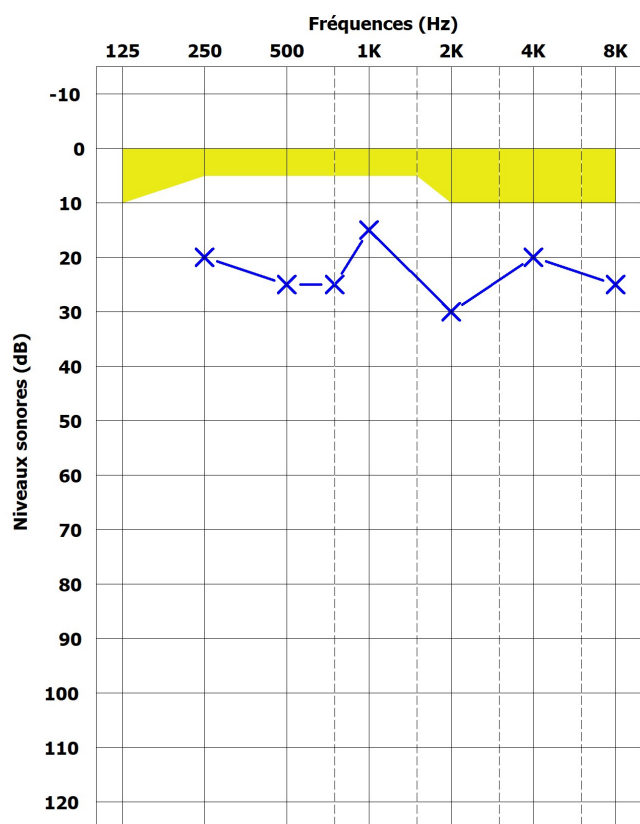

Oreille Gauche

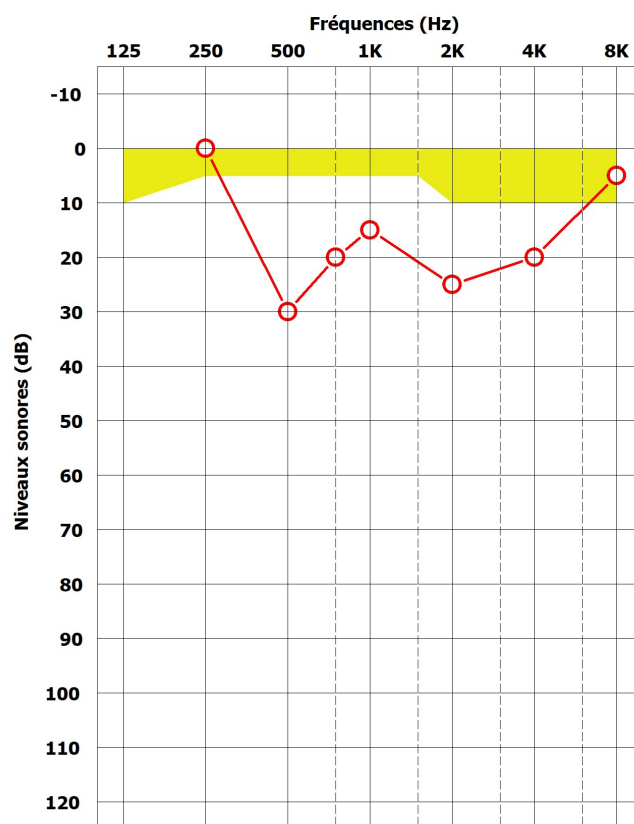

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	15		30		20		25
CA Droit		0	30	20	15		25		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes