



| Données Patient   |                   | DIAKITE MORY |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Date de naissance | 01/01/1980        |              |
| Age               | 45                |              |
| Société           | CR18              |              |
| ID                | 25010314093071924 |              |

Date du test: 03/01/2025 14:11:46  
 Durée: 6mn 08s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

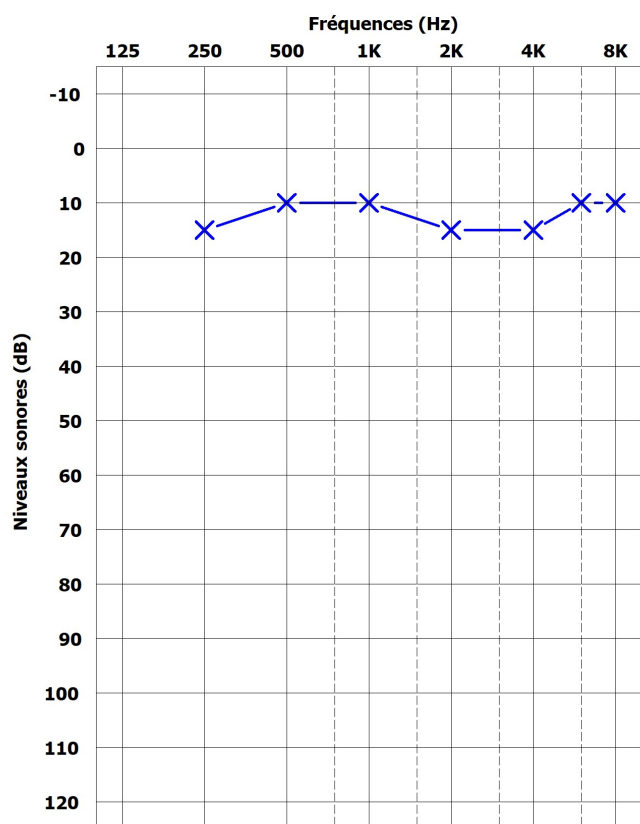

Oreille Gauche

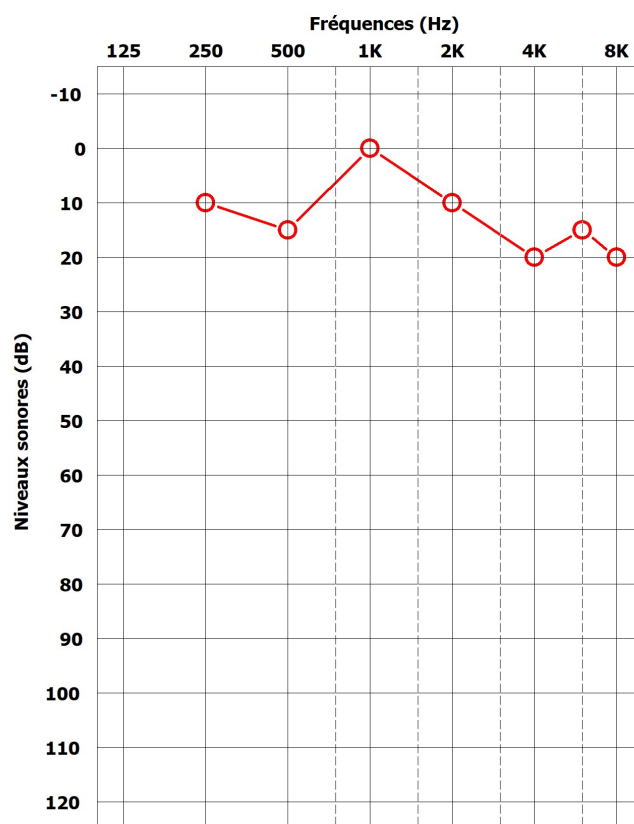

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 10  |     | 10 |     | 15 |    | 15 | 10 | 10 |
| CA Droit  |     | 10  | 15  |     | 0  |     | 10 |    | 20 | 15 | 20 |

|                 |     |         |
|-----------------|-----|---------|
| Calcul de perte | PAM |         |
| CA Gauche       | --- | 10,0 dB |
| CA Droit        | --- | 0,0 dB  |

Notes