

Données Patient


DIAKITE BOUKARY

Date de naissance 01/01/1990
 Age 34
 Société CR18
 ID 24051013220631630


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
 Numéro de série: 2111EAT690093
 Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 10/05/2024 13:28:21
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

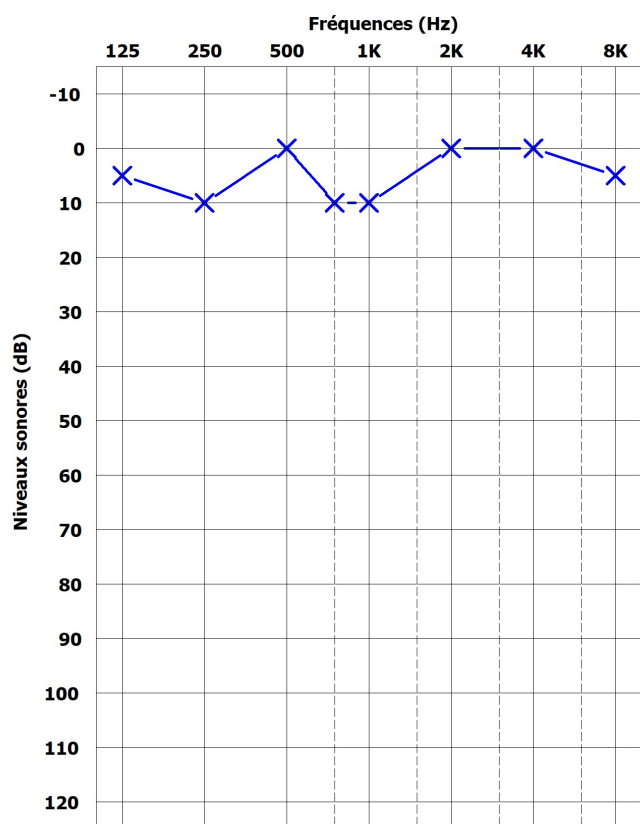

Oreille Gauche

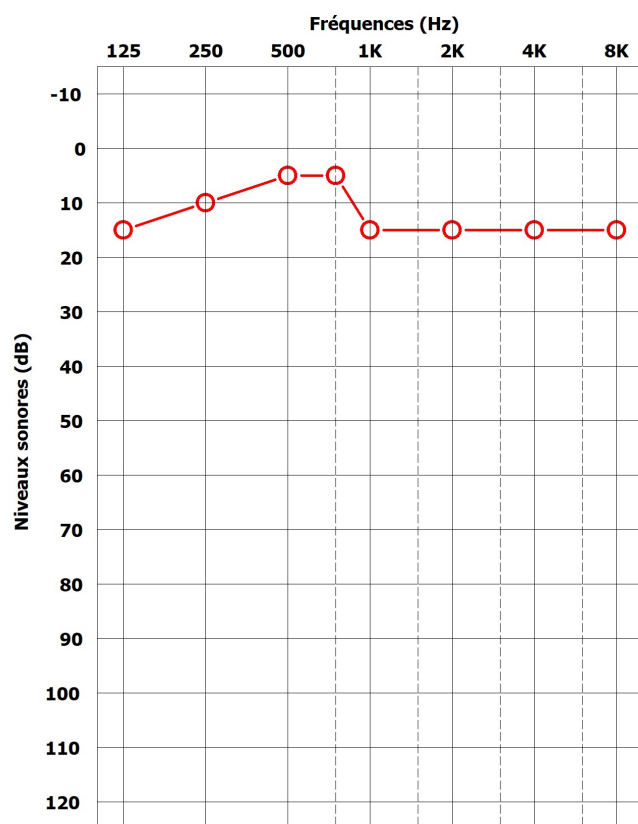

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	10	0	10	10		0		0		5
CA Droit	15	10	5	5	15		15		15		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes