


MEDVIE


Date du test: 18/07/2025 13:49:54
Durée: 3mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CHEN JUN
Date de naissance	16/07/1989	
Age	36	
Société	CR18	
ID	25071813441890046	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

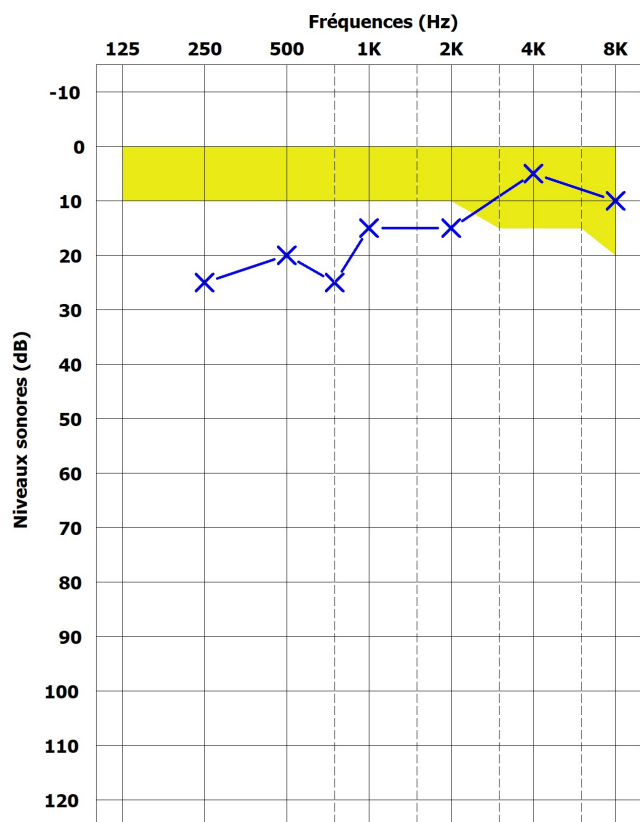

Oreille Gauche

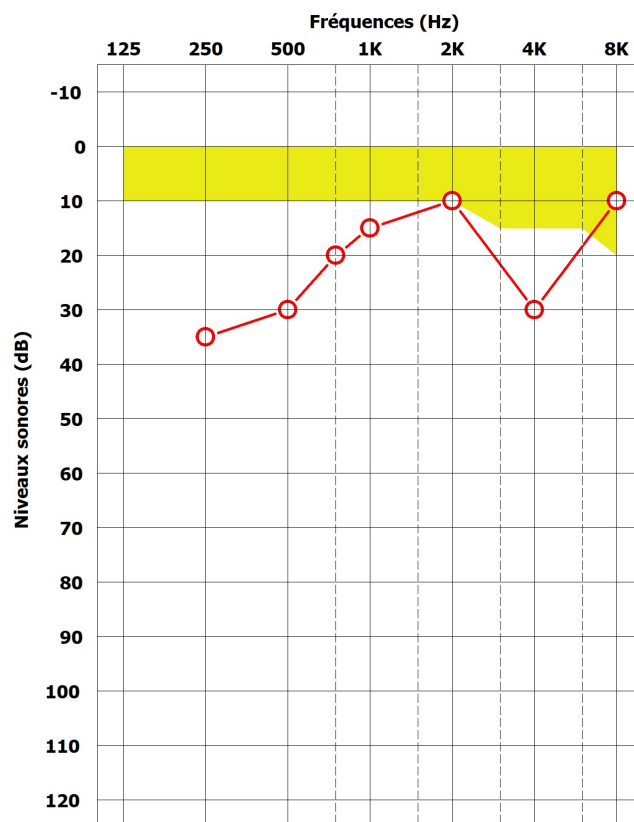

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	25	15		15		5		10
CA Droit		35	30	20	15		10		30		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes