



Données Patient		FAN JIAAN
Date de naissance	26/04/1989	
Age	35	
Société	CR18	
ID	25040314432732644	

Date du test: 03/04/2025 14:49:26
Durée: 4mn 28s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

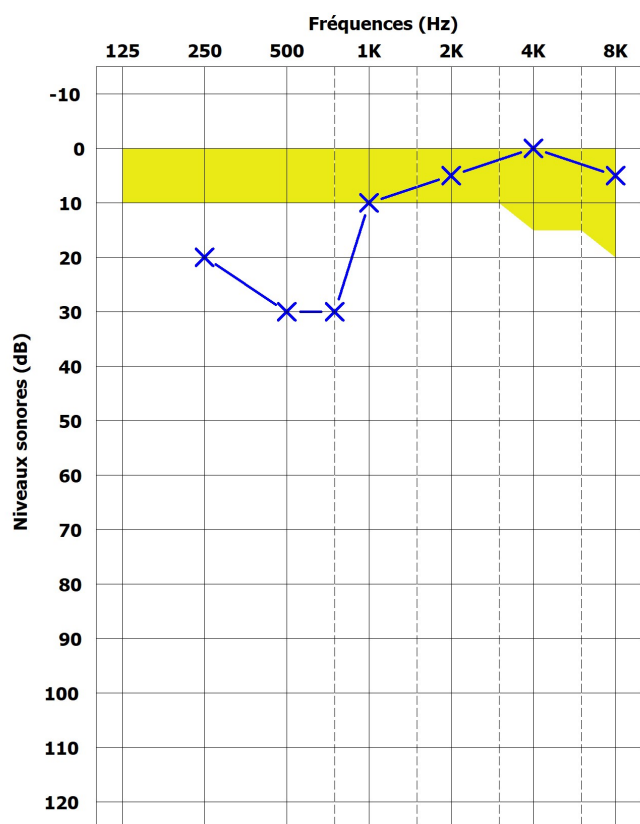

Oreille Gauche

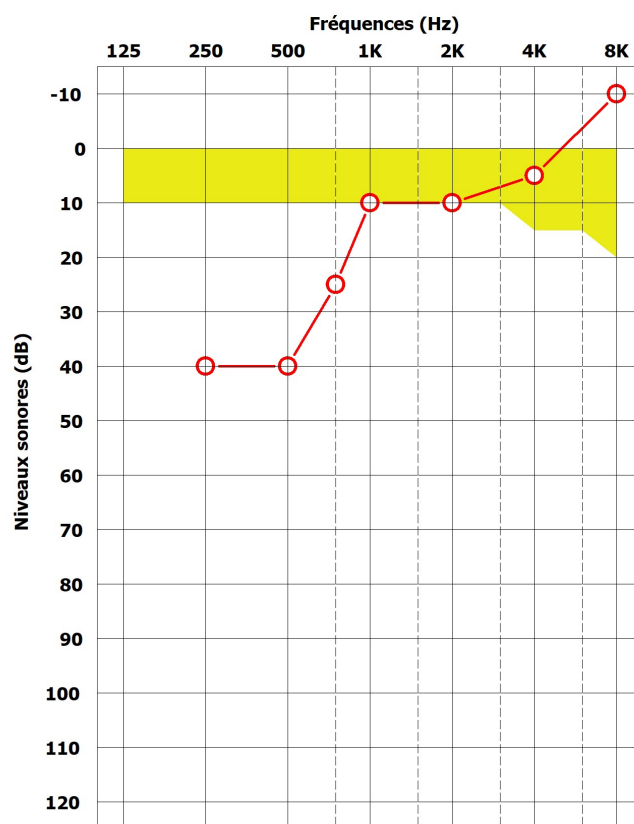

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	30	30	10		5		0		5
CA Droit		40	40	25	10		10		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes