


MEDVIE


Date du test: 08/10/2024 14:21:58
Durée: 4mn 21s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TOUNKARA GERMAINE	
Date de naissance	05/01/2002
Age	22
Société	CR18
ID	24100814191880856

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

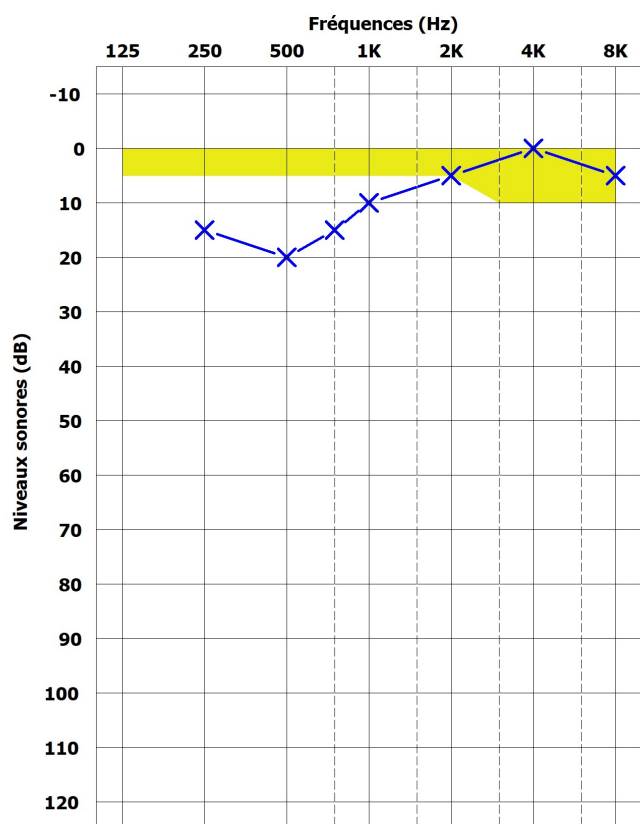

Oreille Gauche

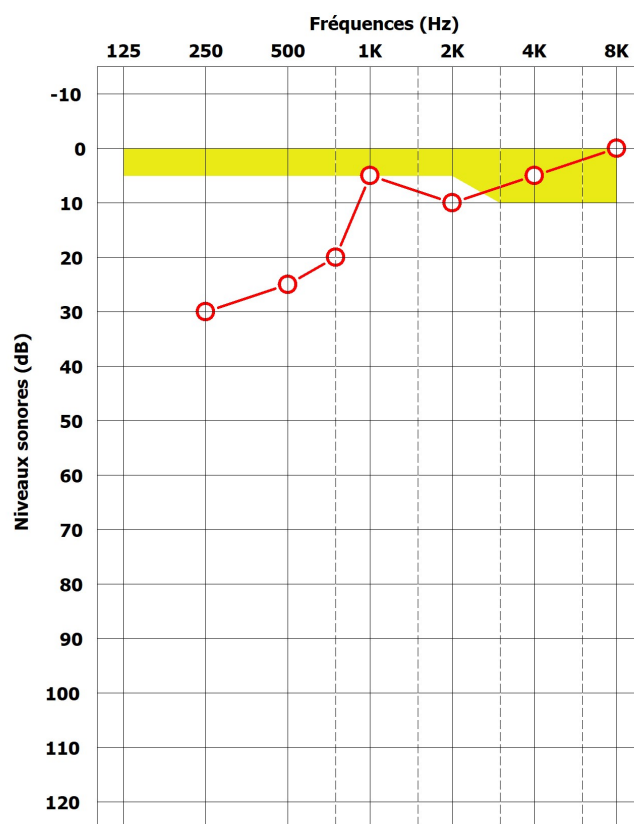

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	10		5		0		5
CA Droit		30	25	20	5		10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes