


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 14:29:16
Durée: 4mn 27s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOMPARE ABOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1994
Age	31
Société	CR18
ID	25031414274197781

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

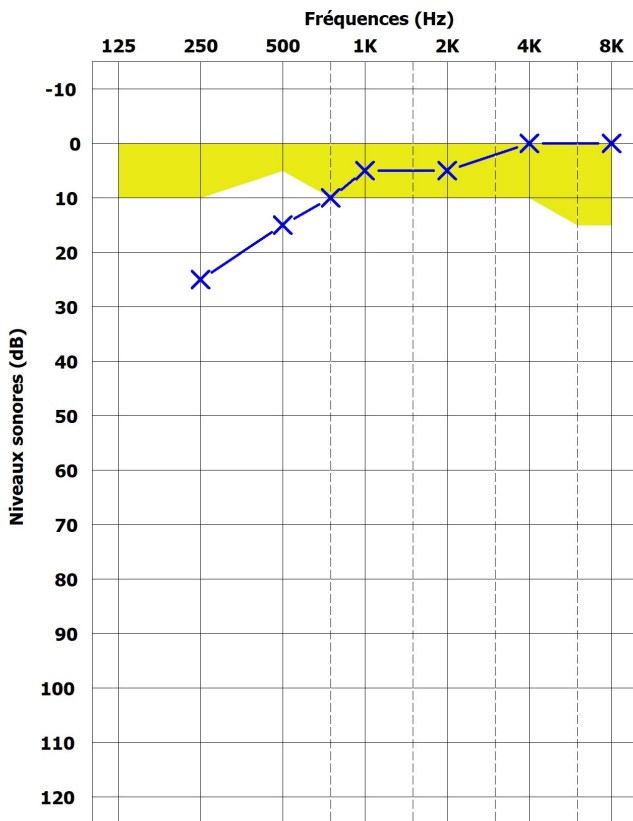

Oreille Gauche

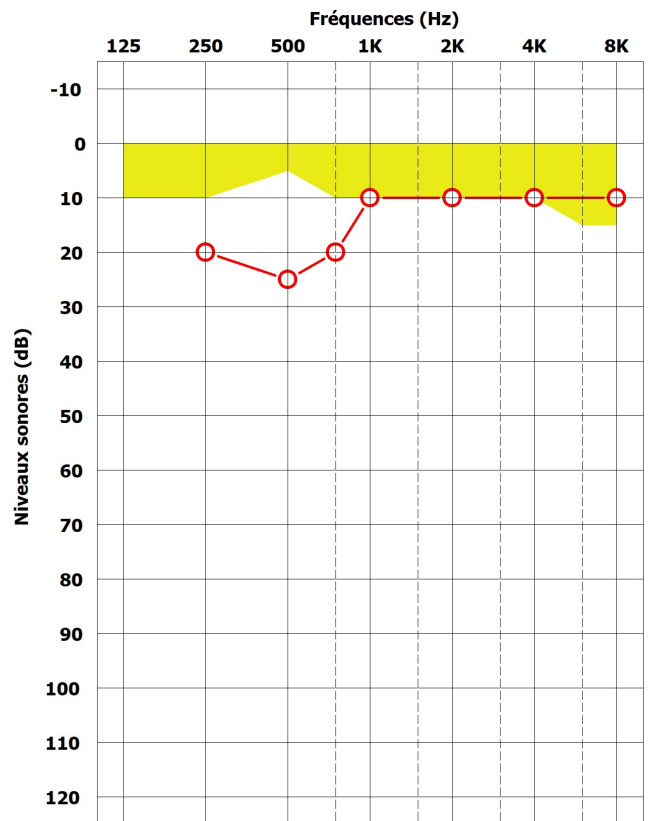

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	10	5		5		0		0
CA Droit		20	25	20	10		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes