

MEDVIE BEYLA


Date du test: 02/01/2025 13:29:57

Durée: 4mn 57s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE ADAMA
Date de naissance	02/05/2001	
Age	23	
Société	CR18	
ID	25010213240708244	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

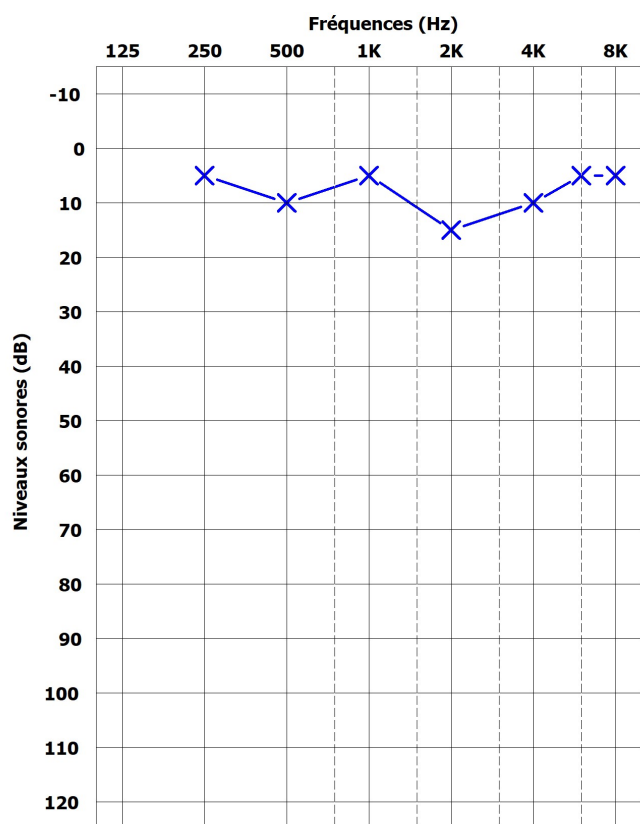

Oreille Gauche

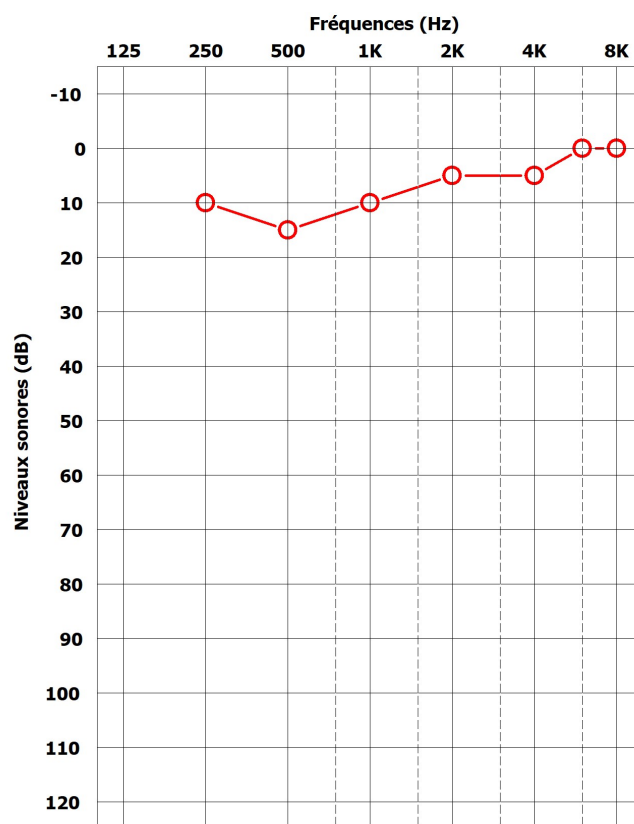

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10		5		15		10	5	5
CA Droit		10	15		10		5		5	0	0

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes