



Données Patient


KOUROUMA BANDJOU

Date de naissance 01/07/1990
Age 34
Société CR18
ID 25011015090690629


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 10/01/2025 15:16:25
Durée: 4mn 53s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

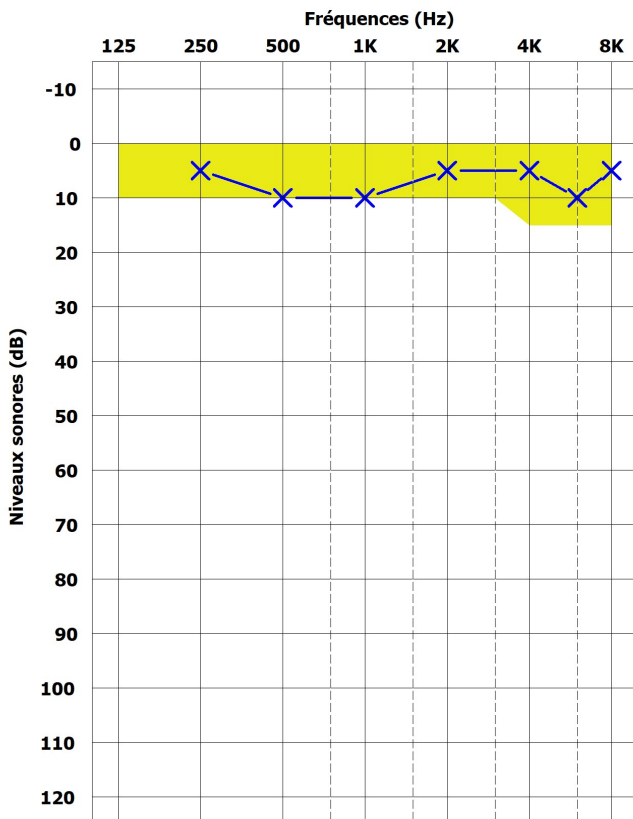

Oreille Gauche

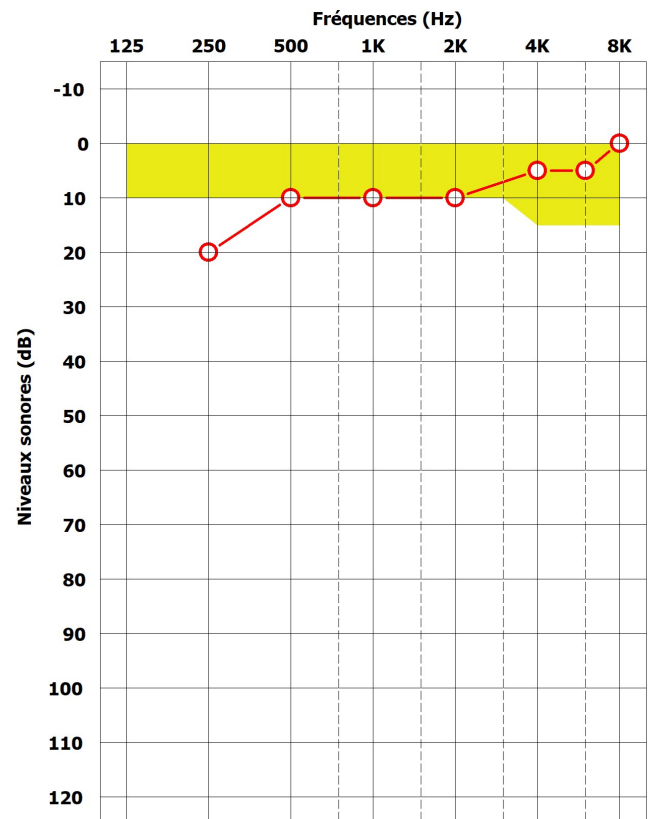

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10		10		5		5	10	5
CA Droit		20	10		10		10		5	5	0

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes