

Données Patient


**BAOGUI ZENG**

Date de naissance 19/05/1979  
Age 46  
Société CR18  
ID 25063015045194897


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211  
Numéro de série: 2111EAT690092  
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 30/06/2025 15:18:18  
Durée: 7mn 47s  
Type test Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

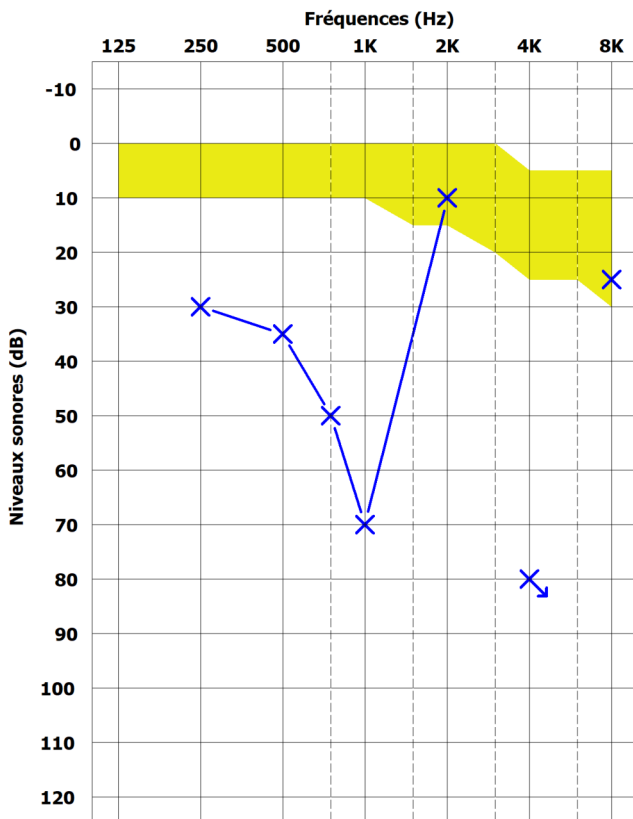

Oreille Gauche

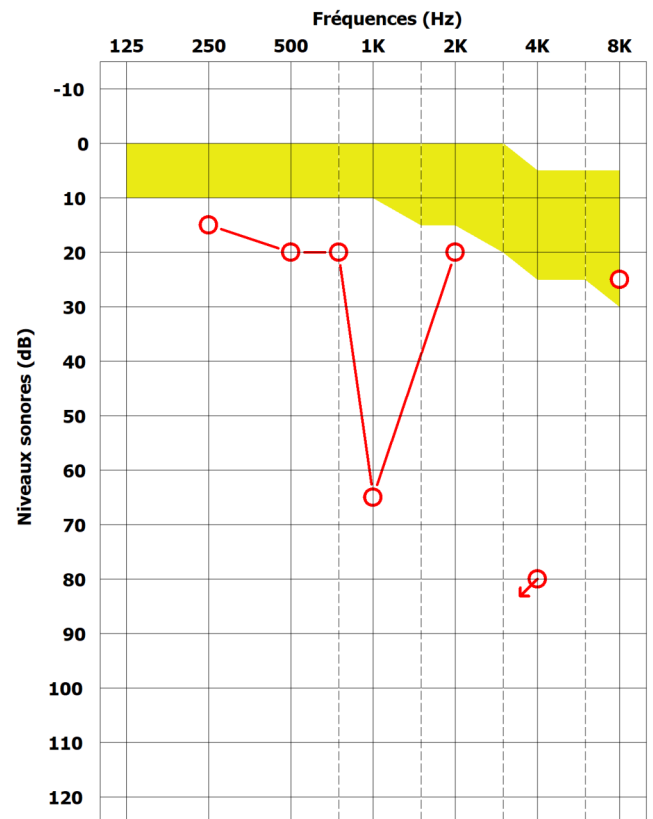

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	35	50	70		10		(80)		25
CA Droit		15	20	20	65		20		(80)		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	---	---

Notes