


Données Patient	
KOUROUMA MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24121011510913119


MEDVIE

Date du test: 10/12/2024 11:53:13
Durée: 5mn 05s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

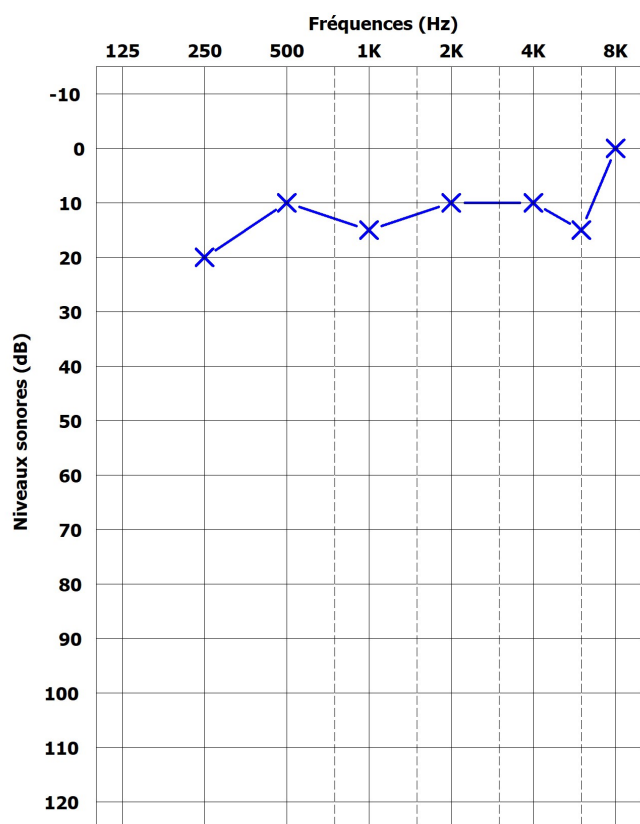

Oreille Gauche

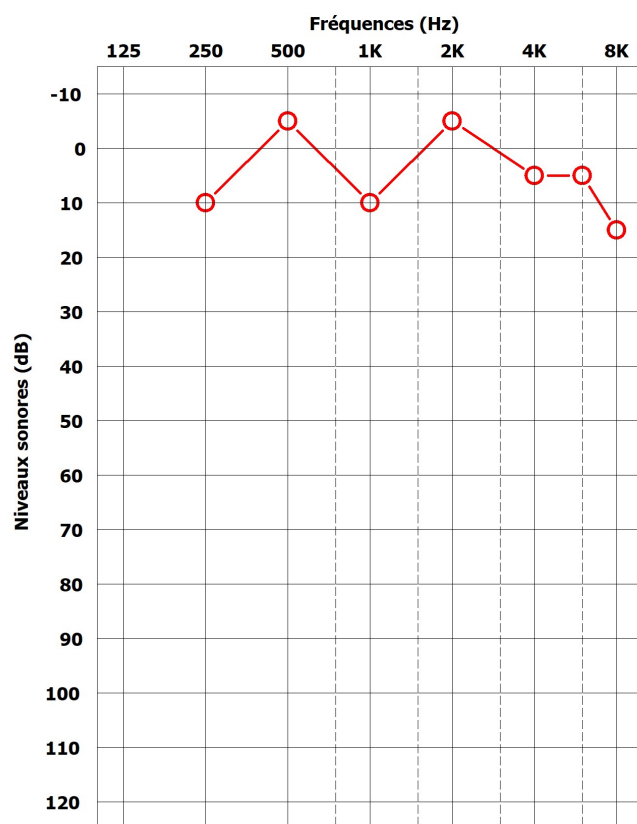

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	10		15		10		10	15	0
CA Droit		10	-5		10		-5		5	5	15

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes