


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 16:25:18

Durée: 7mn 52s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

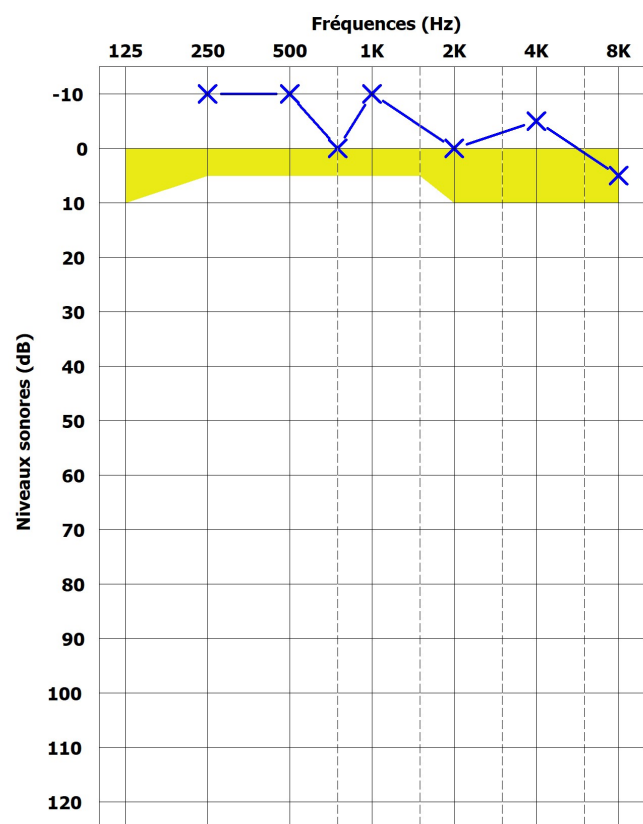

Oreille Gauche

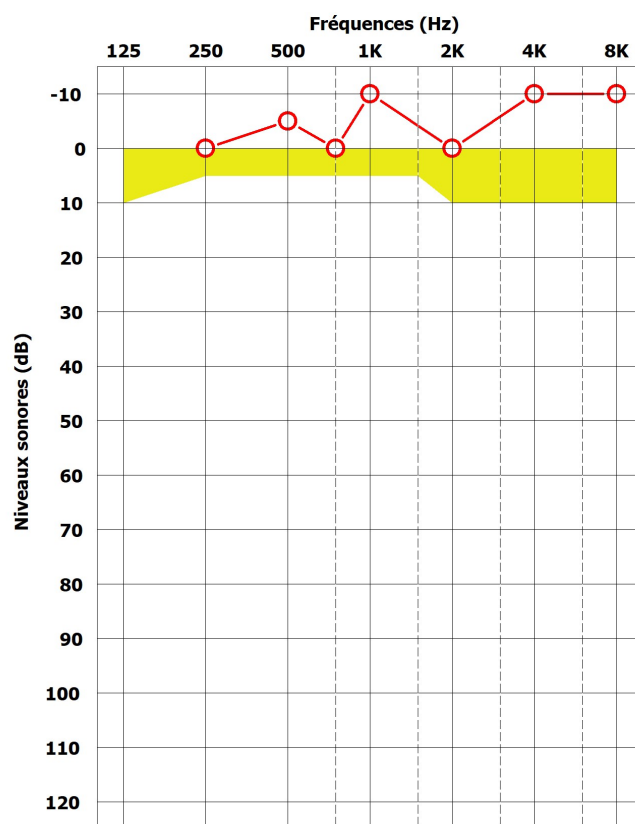

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	0	-10		0		-5		5
CA Droit		0	-5	0	-10		0		-10		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	-6,3 dB	---
CA Droit	-6,3 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO SIAKA
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24093016184161027

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021