


MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 10:38:15

Durée: 3mn 54s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

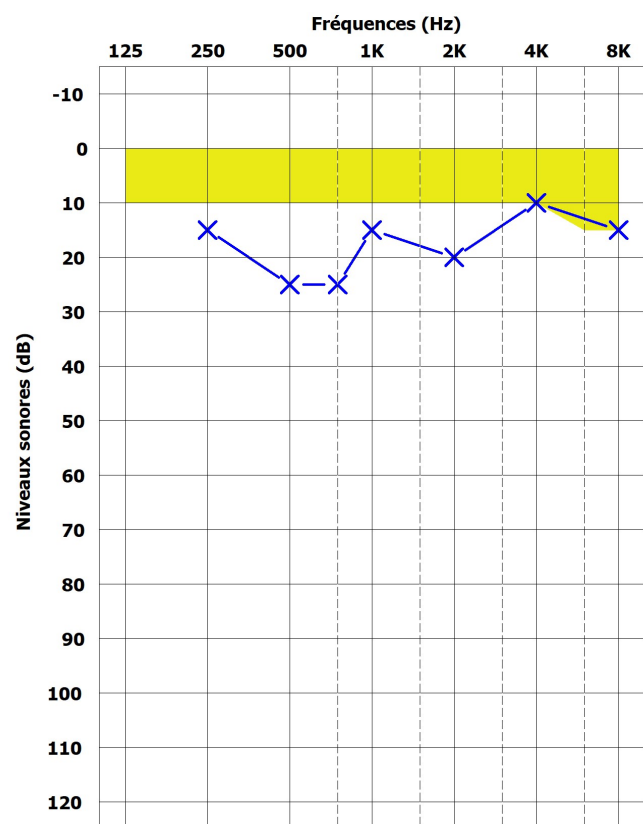

Oreille Gauche

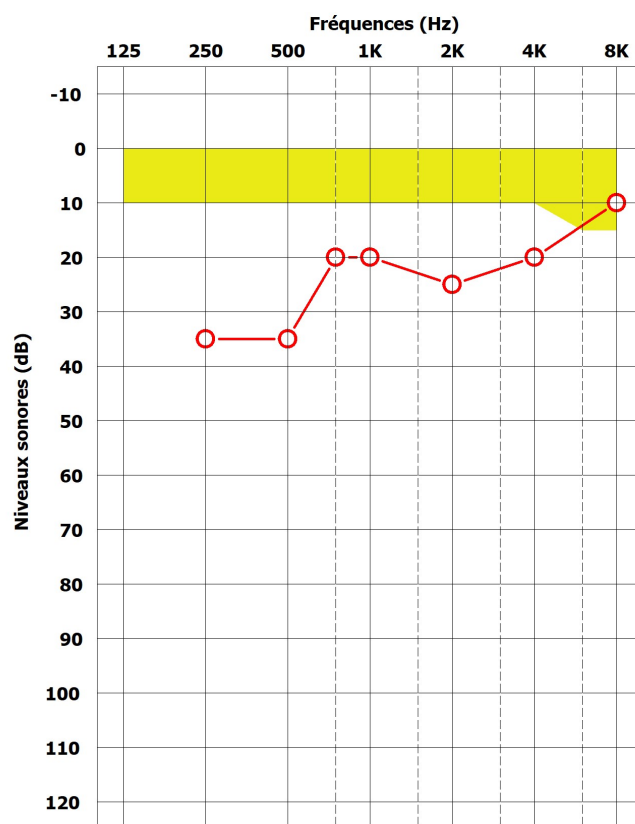

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 25  | 25  | 15 |     | 20 |    | 10 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 35  | 35  | 20  | 20 |     | 25 |    | 20 |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 17,5 dB | --- |
| CA Droit        | 25,0 dB | --- |

Notes

| Données Patient   | DIABATE FATOUMATA |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 10/06/1988        |
| Age               | 36                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 25031210335020934 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |