


MEDVIE


Date du test: 25/05/2024 10:19:16
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		FOFANA SEKOU
Date de naissance	01/01/1994	
Age	30	
Société	CR18	
ID	24052510163026186	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

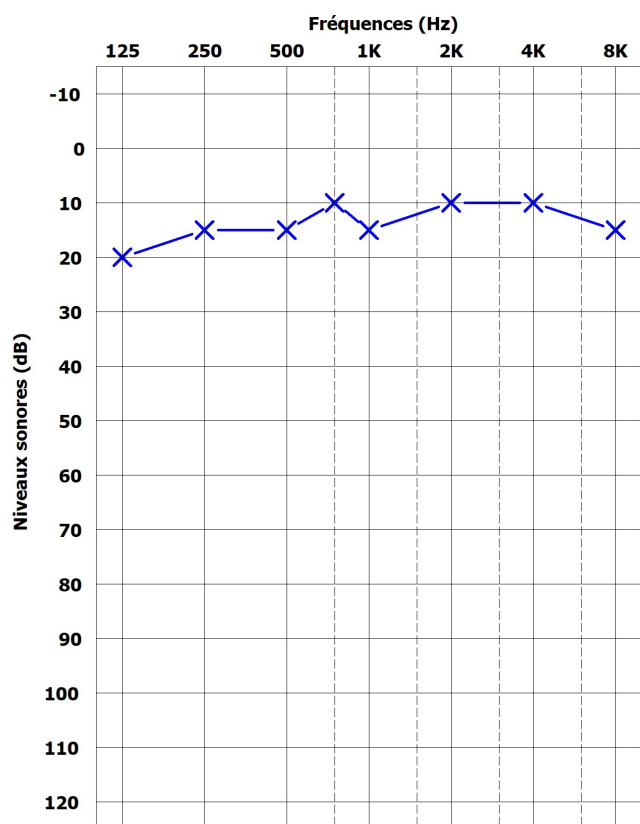

Oreille Gauche

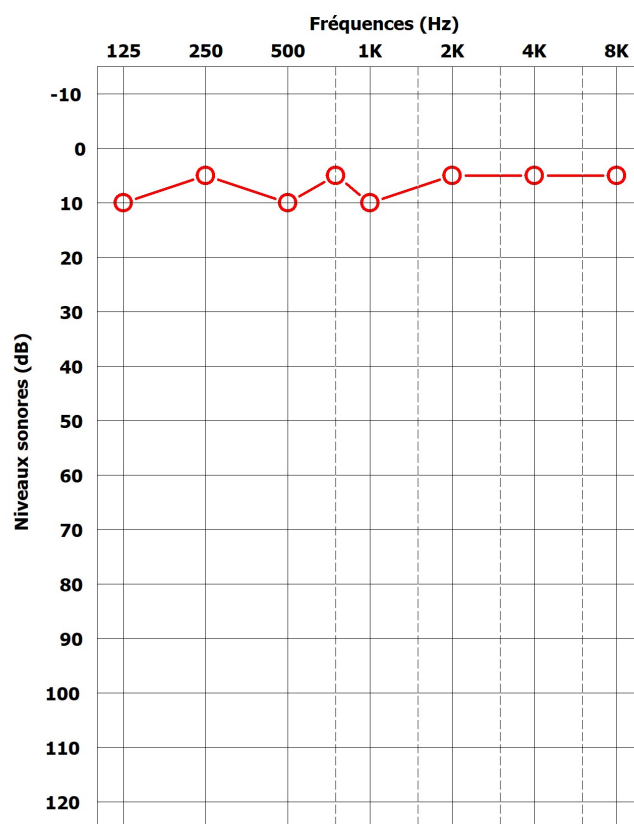

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	10	15		10		10		15
CA Droit	10	5	10	5	10		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes