


Données Patient		SANOH SIAKA
Date de naissance	01/01/1985	
Age	39	
Société	CR18	
ID	24050200094220294	


MEDVIE

Date du test: 02/05/2024 00:11:27
 Durée: 10mn 30s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

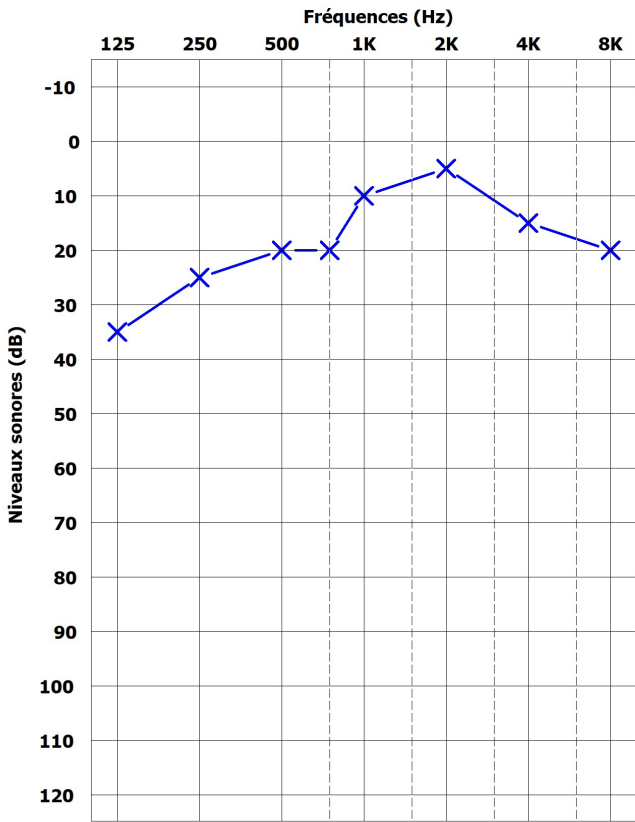

Oreille Gauche

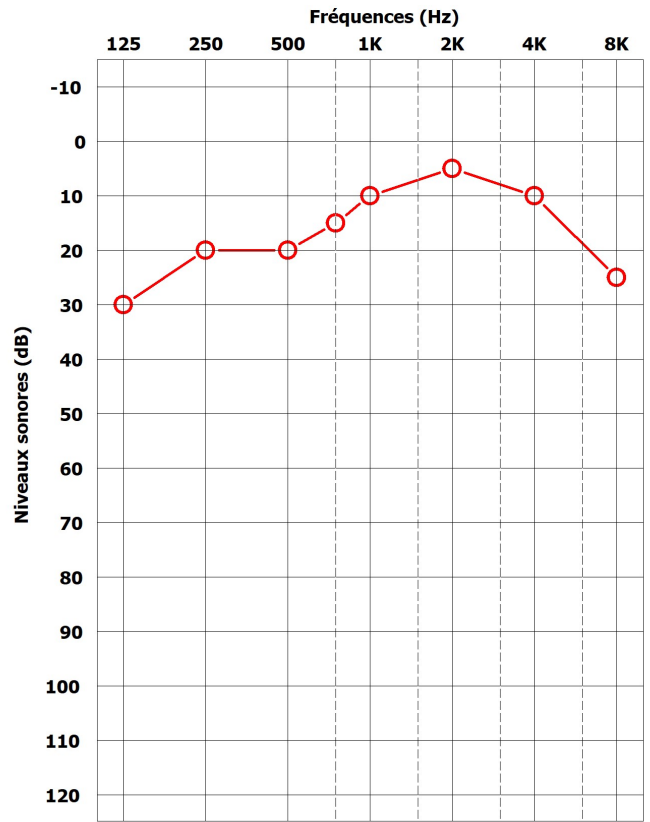

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	25	20	20	10		5		15		20
CA Droit	30	20	20	15	10		5		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	12,5 dB
CA Droit	11,3 dB	---

Notes