


MEDVIE

Date du test: 02/05/2024 13:13:32


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

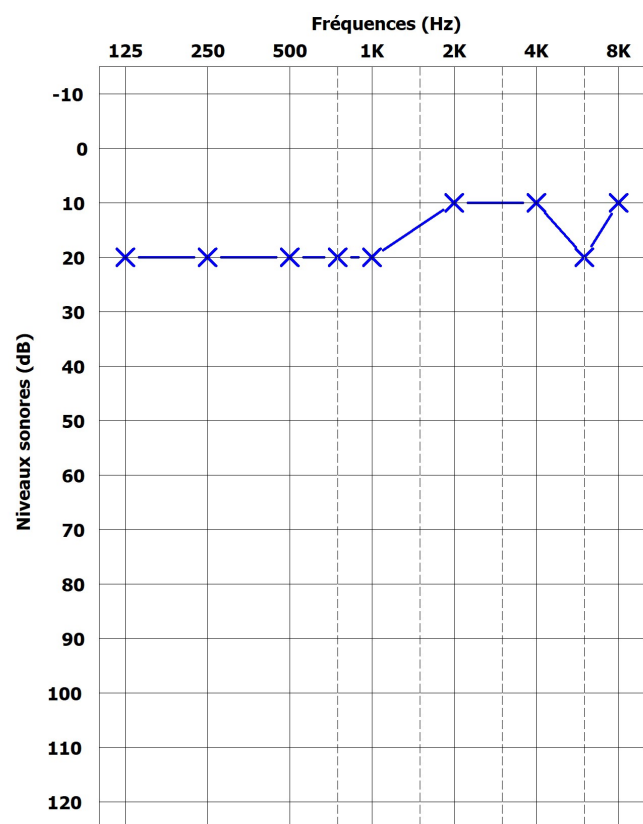

Oreille Gauche

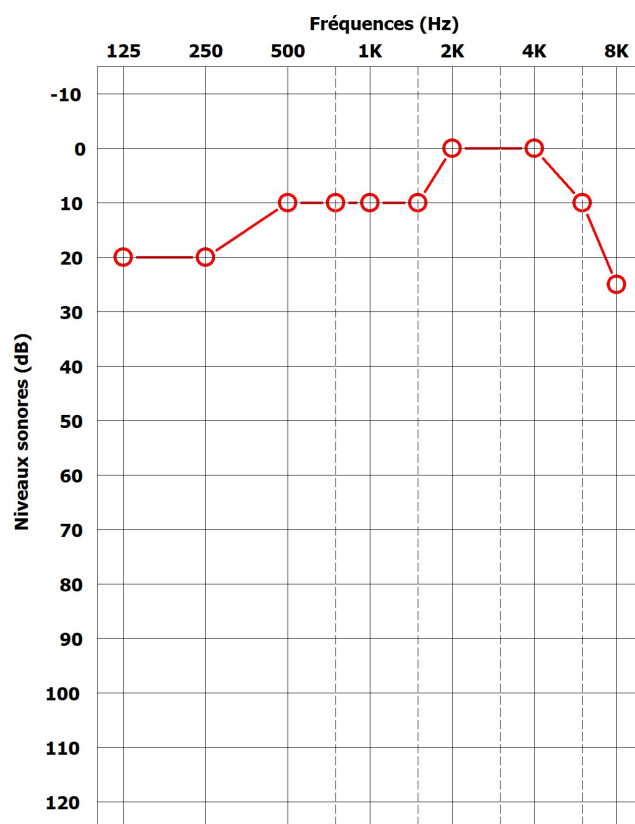

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 20  | 20  | 20  | 20  | 20 |     | 10 |    | 10 | 20 | 10 |
| CA Droit  | 20  | 20  | 10  | 10  | 10 | 10  | 0  |    | 0  | 10 | 25 |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 15,0 dB | --- |
| CA Droit  | 5,0 dB  | --- |

Notes

Données Patient

**BAKRY MAMADOU**  
**IRRAHIMA**

Date de naissance

01/01/1994

Age

30

Société

CR18

ID

24050213080448041

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021