


MEDVIE


Date du test: 31/05/2024 15:41:11
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	KONATE MORY
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24053115400339252

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

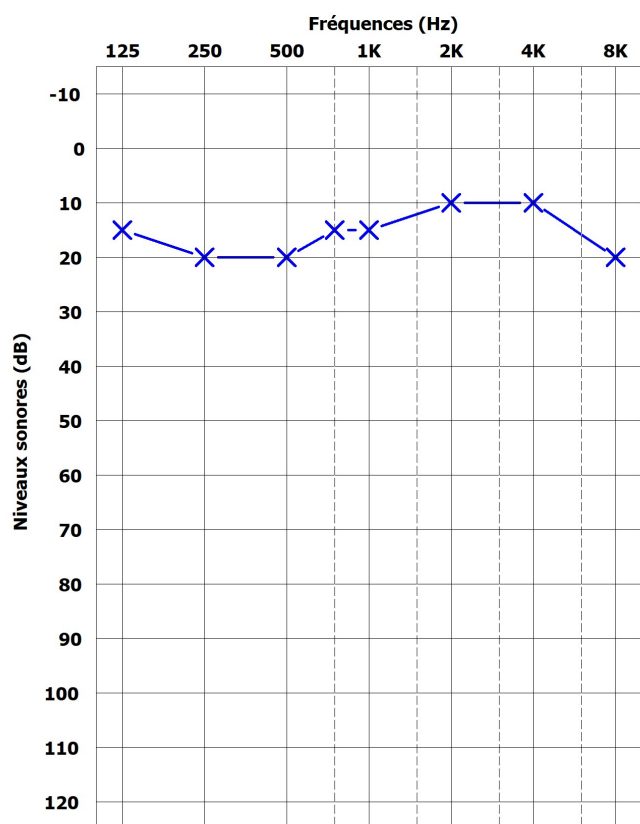

Oreille Gauche

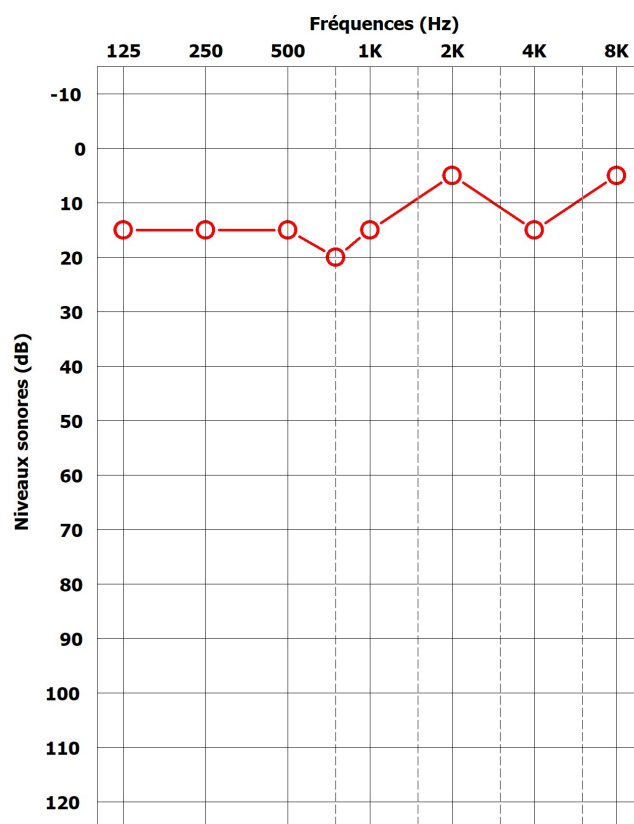

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	20	15	15		10		10		20
CA Droit	15	15	15	20	15		5		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes