

Données Patient


CISSE MORY

Date de naissance 01/01/2004
 Age 20
 Société CR18
 ID 24052014451614376


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
 Numéro de série: 2111EAT690093
 Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 20/05/2024 14:48:25
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

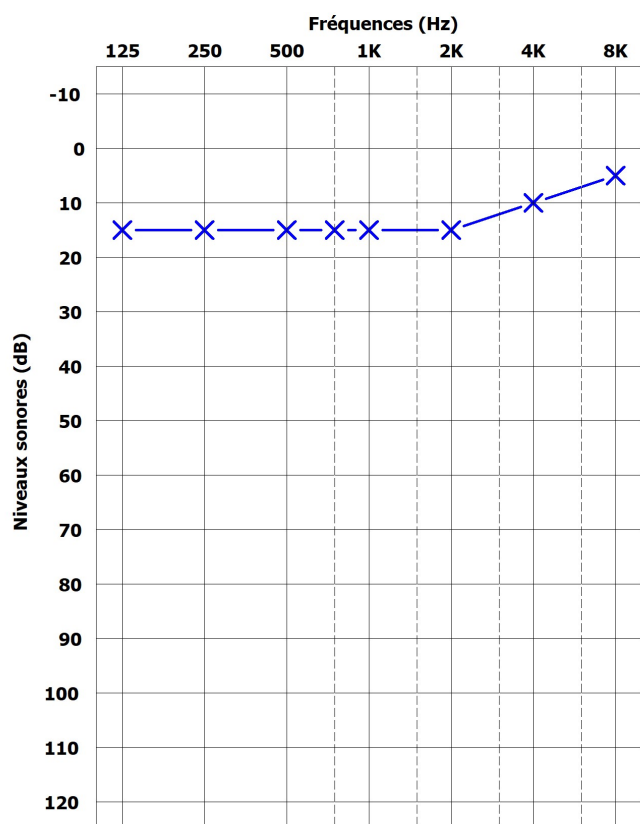

Oreille Gauche

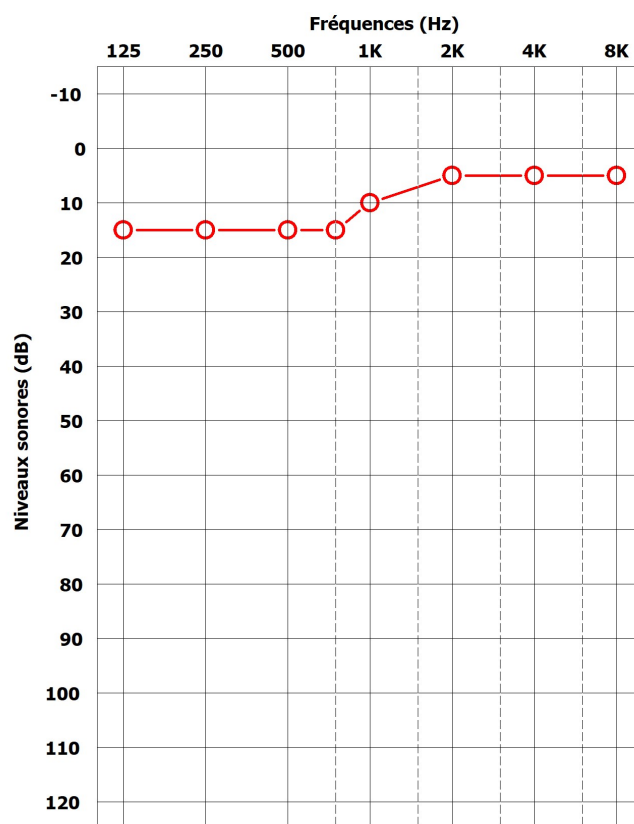

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	15	15	15		15		10		5
CA Droit	15	15	15	15	10		5		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes