


MEDVIE


Date du test: 09/04/2025 14:55:49  
Durée: 4mn 58s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   | ZHANG PENG |
|-------------------|-------------------|------------|
| Date de naissance | 13/12/1987        |            |
| Age               | 37                |            |
| Société           | CR18              |            |
| ID                | 25040914520120536 |            |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

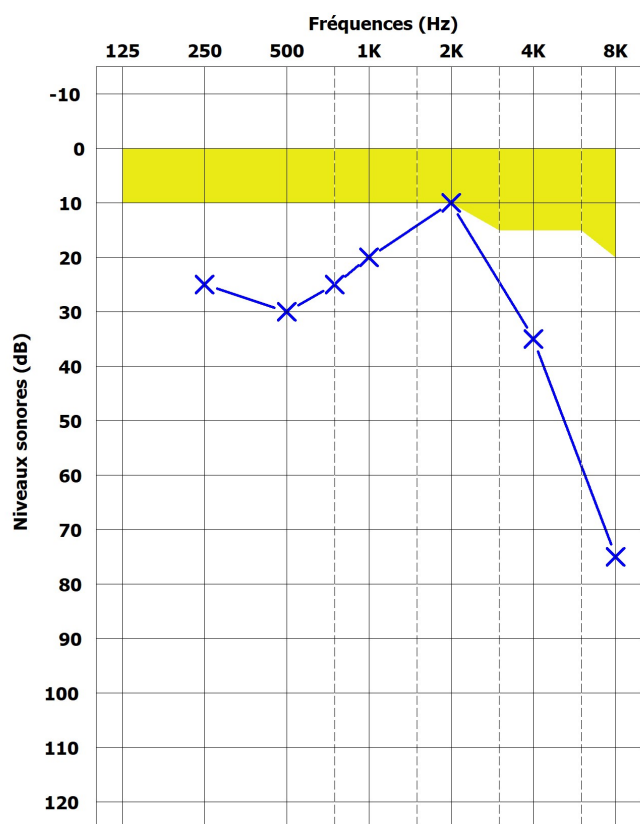

Oreille Gauche

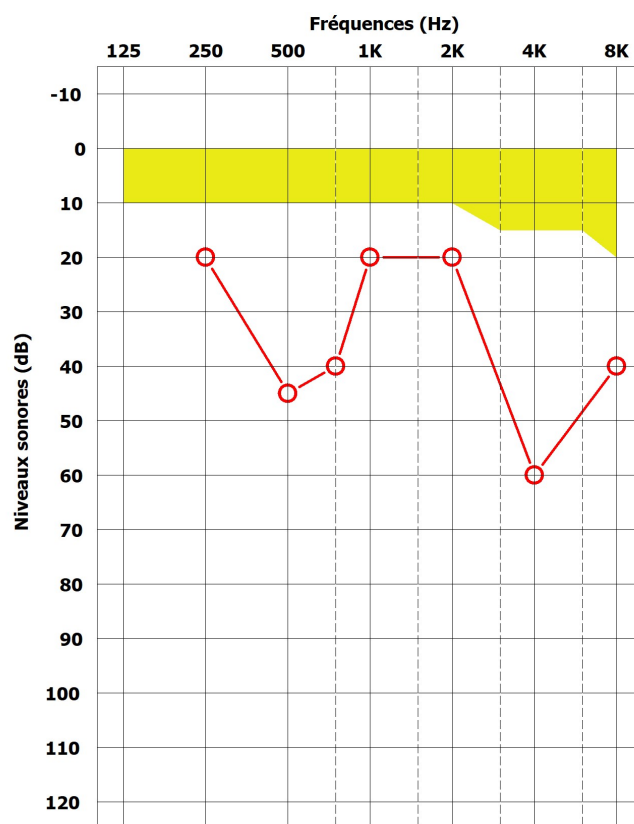

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 30  | 25  | 20 |     | 10 |    | 35 |    | 75 |
| CA Droit  |     | 20  | 45  | 40  | 20 |     | 20 |    | 60 |    | 40 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 23,8 dB | --- |
| CA Droit        | 36,3 dB | --- |

Notes