


MEDVIE


Date du test: 03/10/2024 13:44:03
Durée: 7mn 41s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TRAORE SEKOU	
Date de naissance	08/10/2000
Age	23
Société	CR18
ID	24100313374646049

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

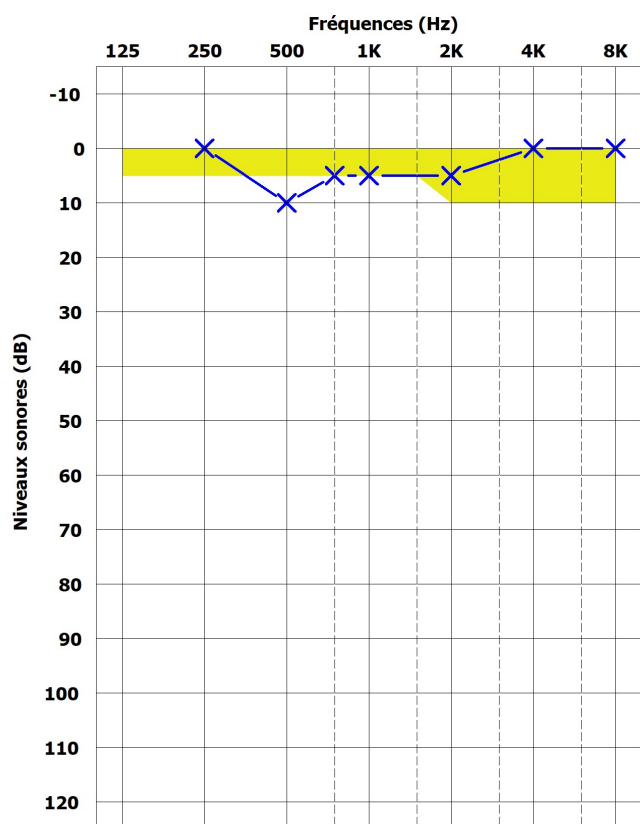

Oreille Gauche

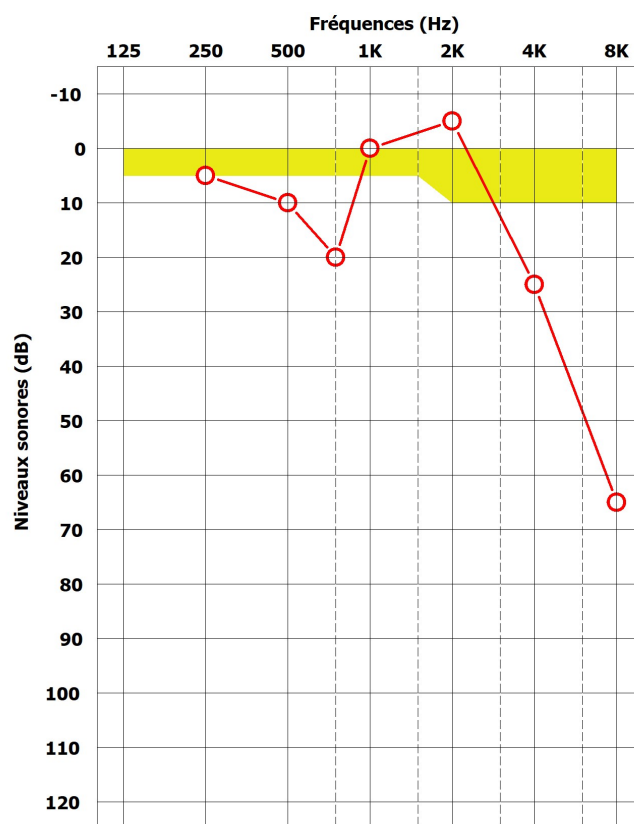

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	5	5		5		0		0
CA Droit		5	10	20	0		-5		25		65

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes