


MEDVIE


Date du test: 08/10/2024 14:10:41  
Durée: 3mn 47s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>BALDE MAMADOU DJAN</b> |                   |
| Date de naissance         | 10/03/1995        |
| Age                       | 29                |
| Société                   | CR18              |
| ID                        | 24100812345256798 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

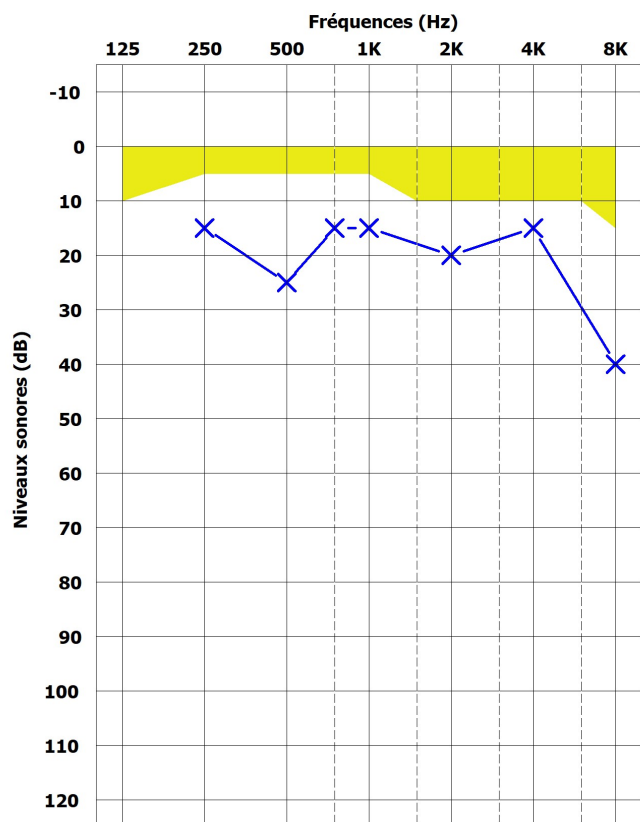

Oreille Gauche

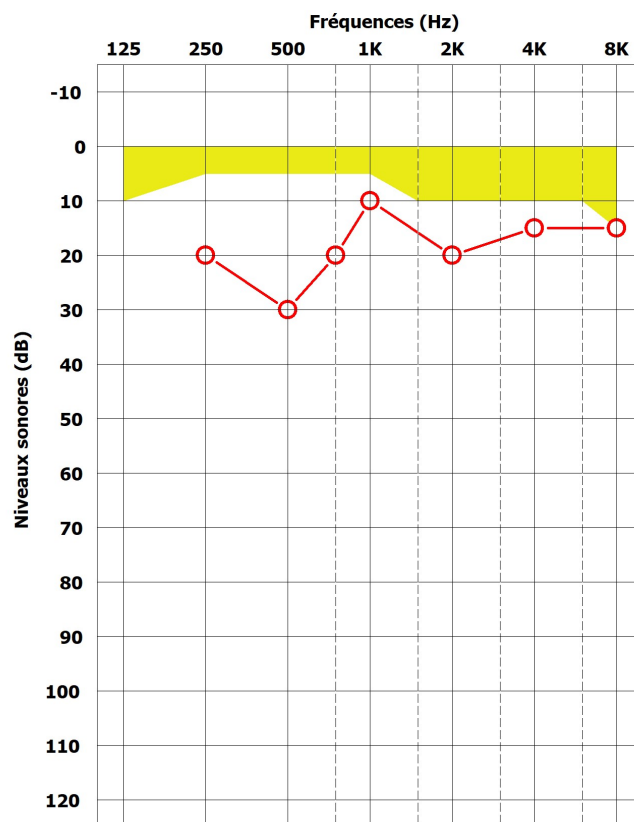

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 25  | 15  | 15 |     | 20 |    | 15 |    | 40 |
| CA Droit  |     | 20  | 30  | 20  | 10 |     | 20 |    | 15 |    | 15 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 18,8 dB | --- |
| CA Droit        | 18,8 dB | --- |

Notes