



Données Patient	TRAORE SAMBOU
Date de naissance	01/01/1985
Age	40
Société	CR18
ID	25010312312407995

Date du test: 03/01/2025 12:33:17
 Durée: 6mn 48s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

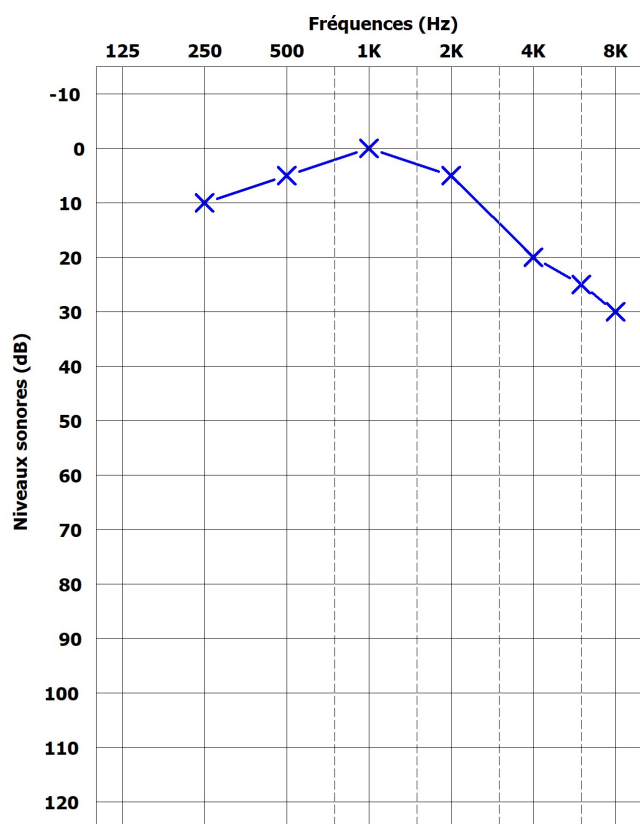

Oreille Gauche

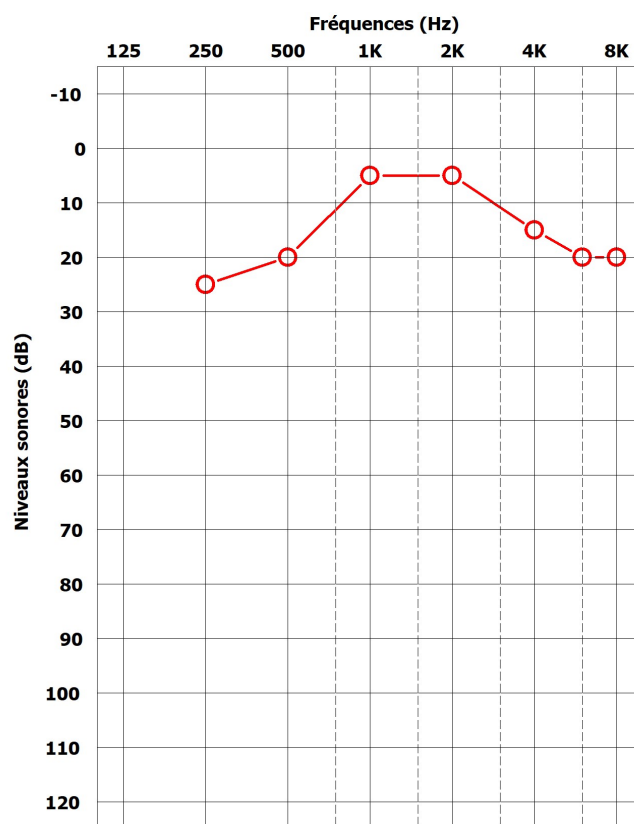

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5		0		5		20	25	30
CA Droit		25	20		5		5		15	20	20

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	0,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes