

MEDVIE


Date du test: 04/07/2025 16:47:29

Durée: 5mn 43s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		LI LIANG
Date de naissance	04/04/1986	
Age	39	
Société	CR18	
ID	25070416454956221	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

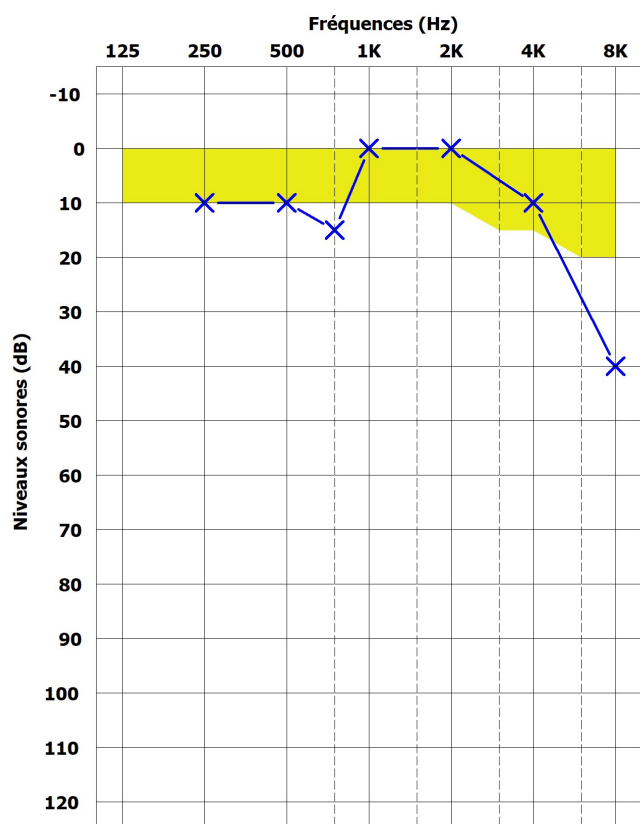

Oreille Gauche

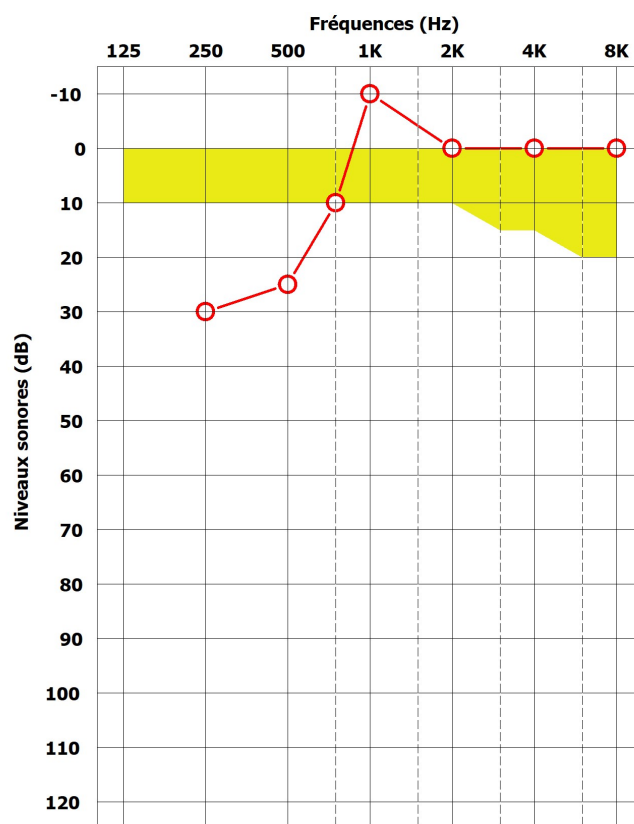

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	15	0		0		10		40
CA Droit		30	25	10	-10		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes