


MEDVIE


Date du test: 17/05/2024 08:55:03
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient		KANTE ANINATA
Date de naissance	01/01/1984	
Age	40	
Société	CR18	
ID	24051708484452149	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

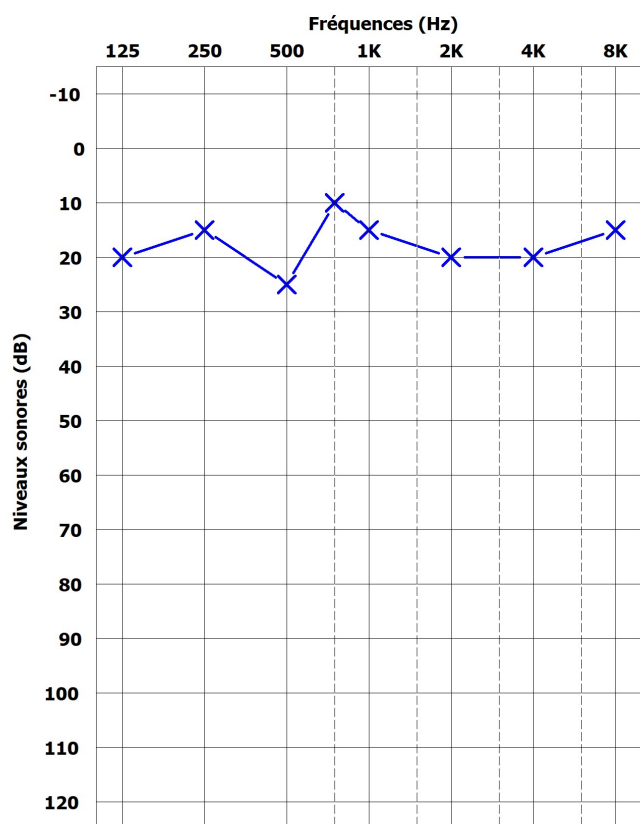

Oreille Gauche

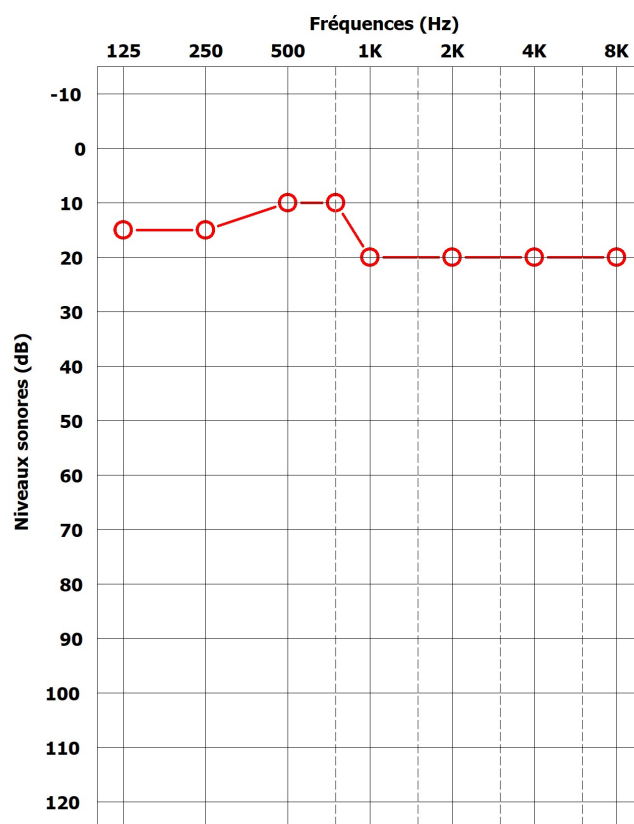

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	25	10	15		20		20		15
CA Droit	15	15	10	10	20		20		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes