

MEDVIE

Date du test: 05/08/2025 16:12:22

Durée: 5mn 57s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CISSE SALIF

Date de naissance 01/01/1997

Age 28

Société CR18


ID 25080515290651264

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

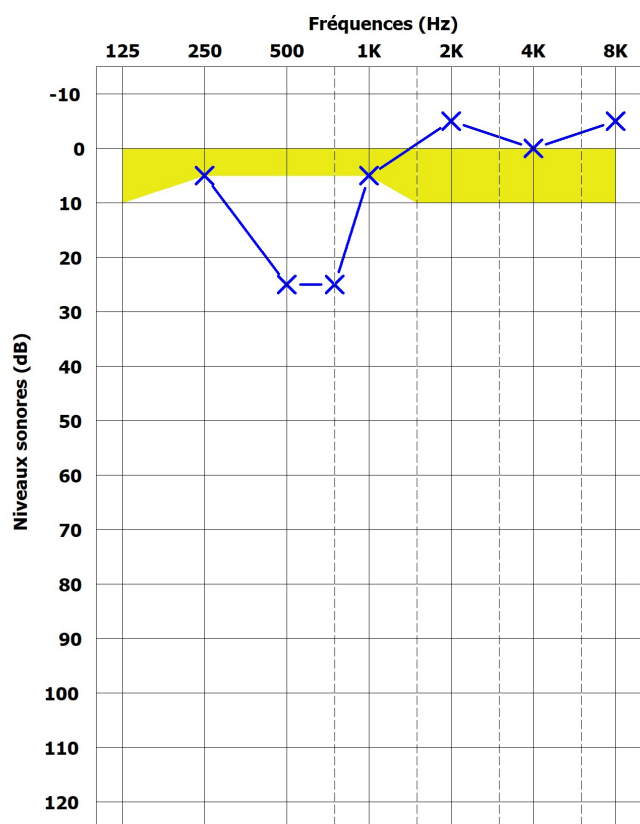

Oreille Gauche

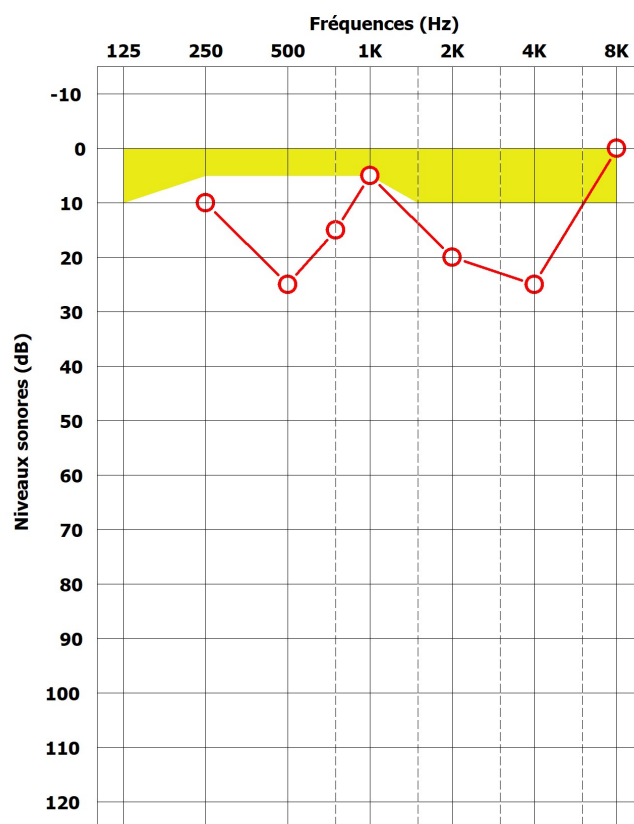

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	25	25	5		-5		0		-5
CA Droit		10	25	15	5		20		25		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes