

MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 12:13:27

Durée: 4mn 47s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE MAMADI
Date de naissance	01/03/1997	
Age	28	
Société	CR18	
ID	25031511525879652	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

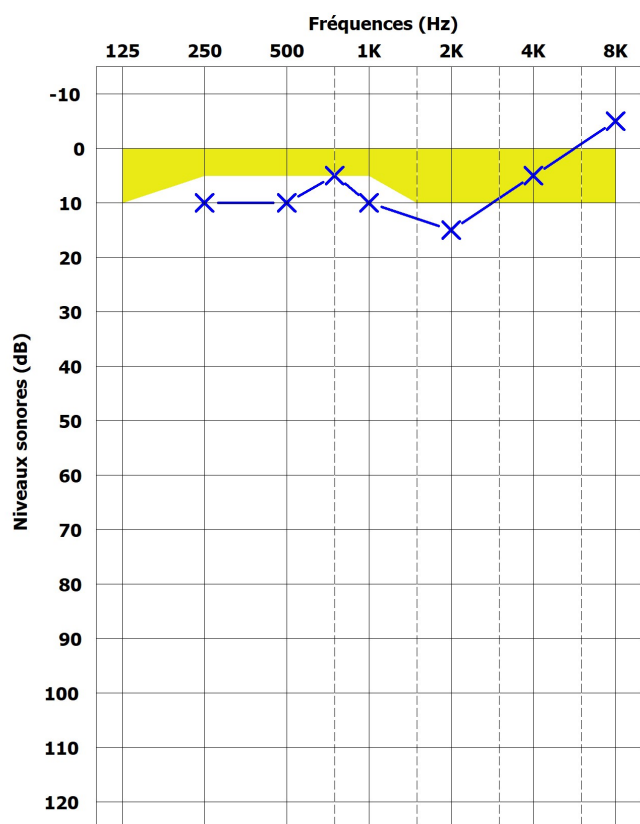

Oreille Gauche

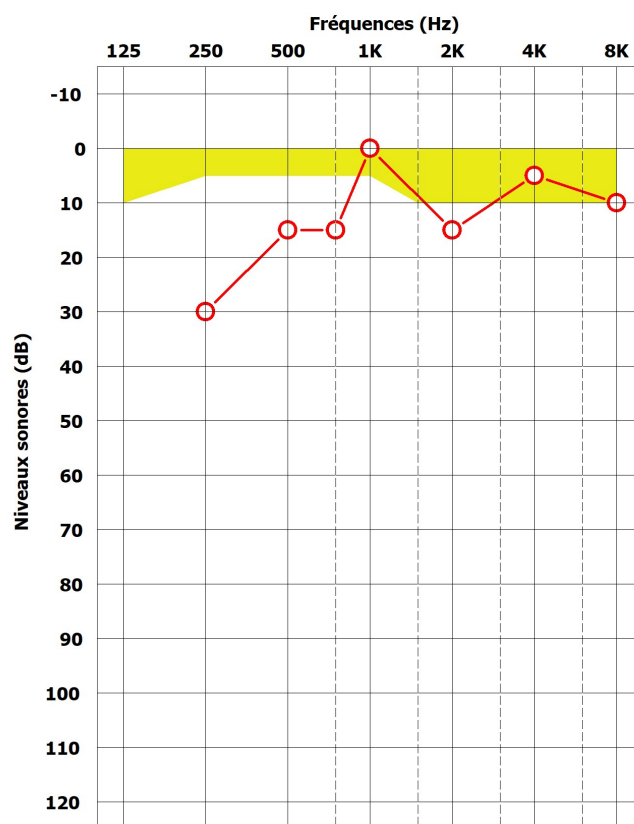

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	5	10		15		5		-5
CA Droit		30	15	15	0		15		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes