

Données Patient


**FOFANA MORY**

Date de naissance 01/01/1991  
Age 33  
Société CR18  
ID 24051010285264686


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211  
Numéro de série: 2111EAT690093  
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 10/05/2024 10:37:34  
Durée: -- mn -- s  
Type test Manuel  
Continu

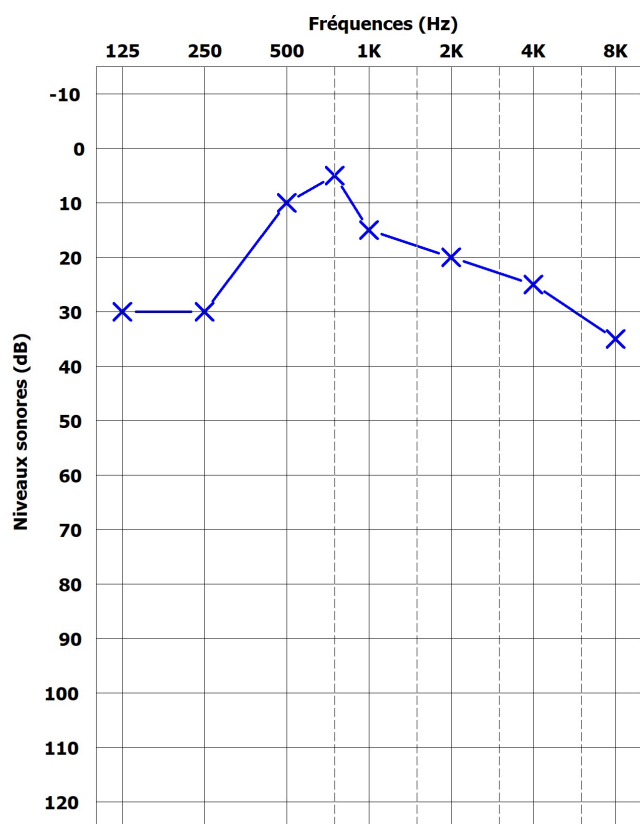

Oreille Gauche

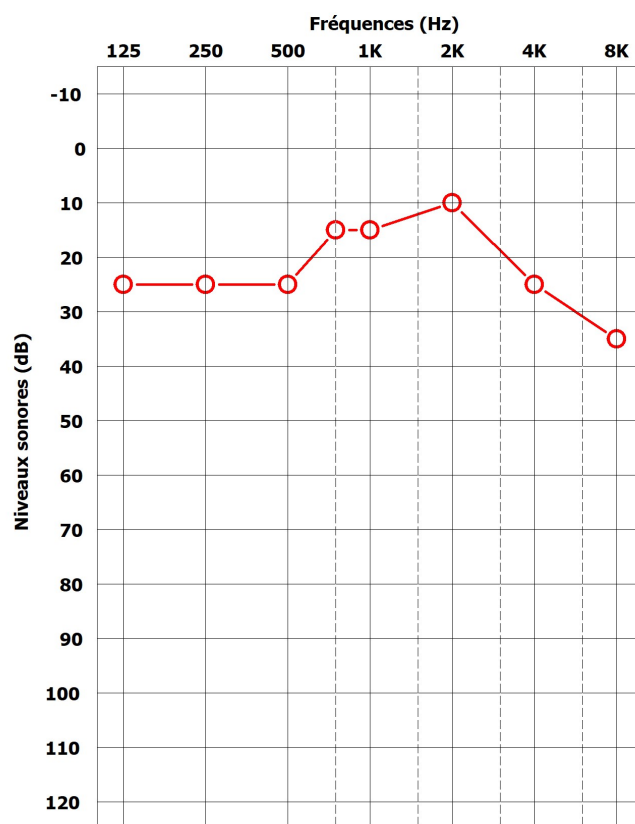

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 30  | 30  | 10  | 5   | 15 |     | 20 |    | 25 |    | 35 |
| CA Droit  | 25  | 25  | 25  | 15  | 15 |     | 10 |    | 25 |    | 35 |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 17,5 dB | --- |
| CA Droit  | 18,8 dB | --- |

Notes