


MEDVIE


Date du test: 03/07/2025 13:02:52
Durée: 5mn 01s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		ENBING HE
Date de naissance	08/08/1979	
Age	45	
Société	CR18	
ID	25070312573766811	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

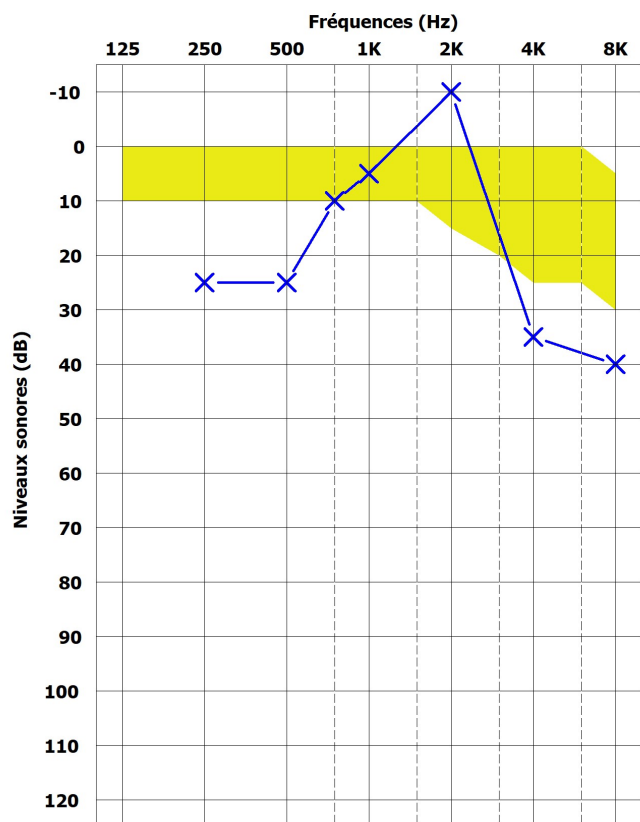

Oreille Gauche

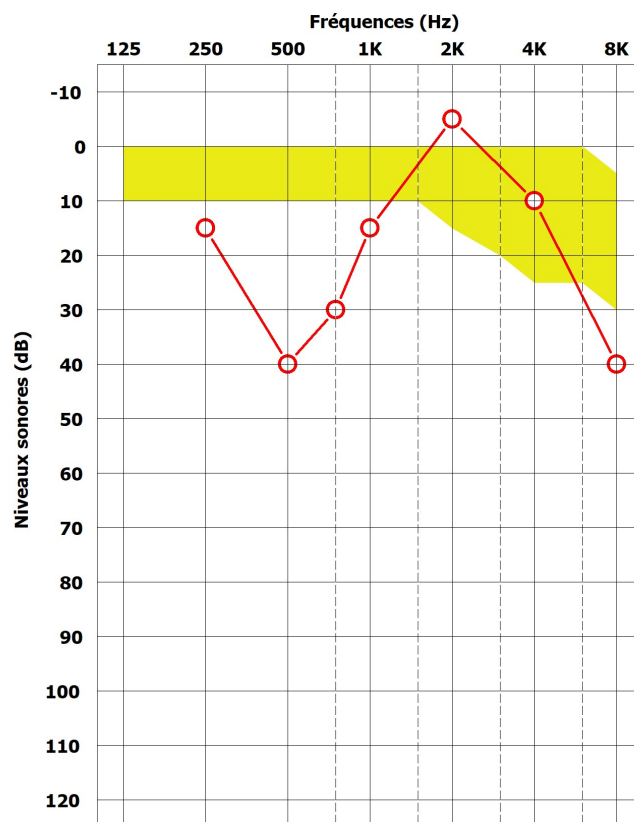

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	10	5		-10		35		40
CA Droit		15	40	30	15		-5		10		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes