


MEDVIE


Date du test: 23/04/2024 13:33:33

Durée: 8mn 01s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

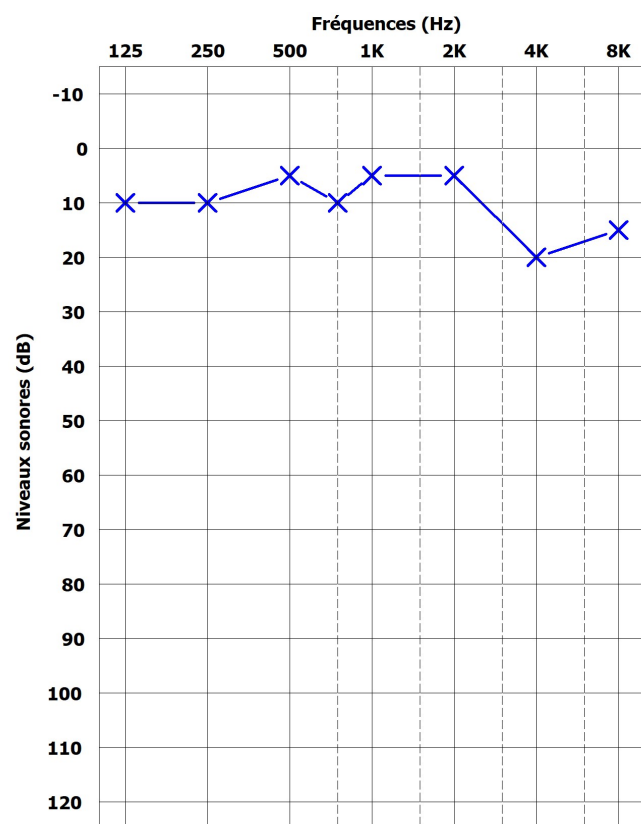

Oreille Gauche

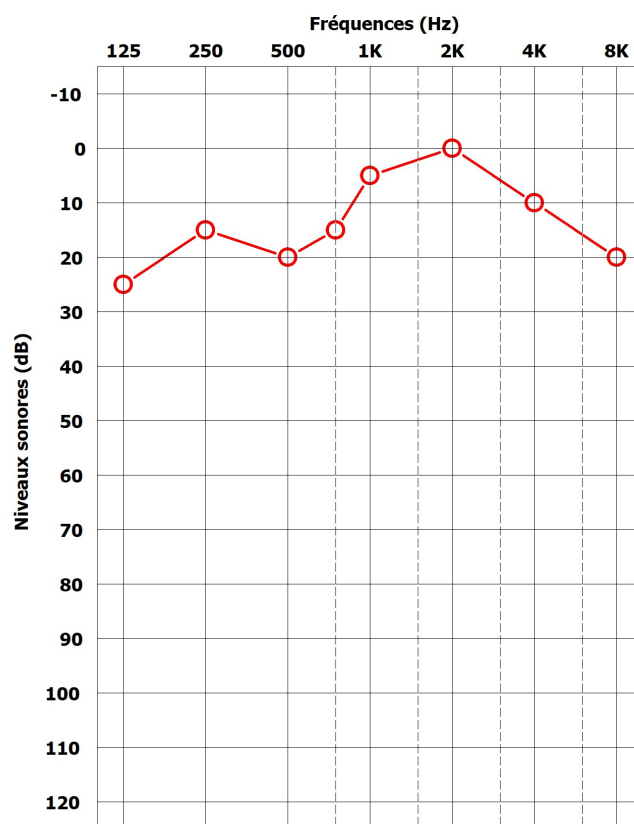

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	10	5	10	5		5		20		15
CA Droit	25	15	20	15	5		0		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes

Données Patient	TRAORE LANCINE
Date de naissance	26/07/1993
Age	30
Société	CR18
ID	24042313201533766

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021