

MEDVIE

Date du test: 01/05/2024 21:28:08

Durée: 10mn 44s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

Données Patient

**MOUROUMA**  
**ARNOYII AYF**

Date de naissance 01/01/1987

Age 37

Société CR18


ID 24050121171385477

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

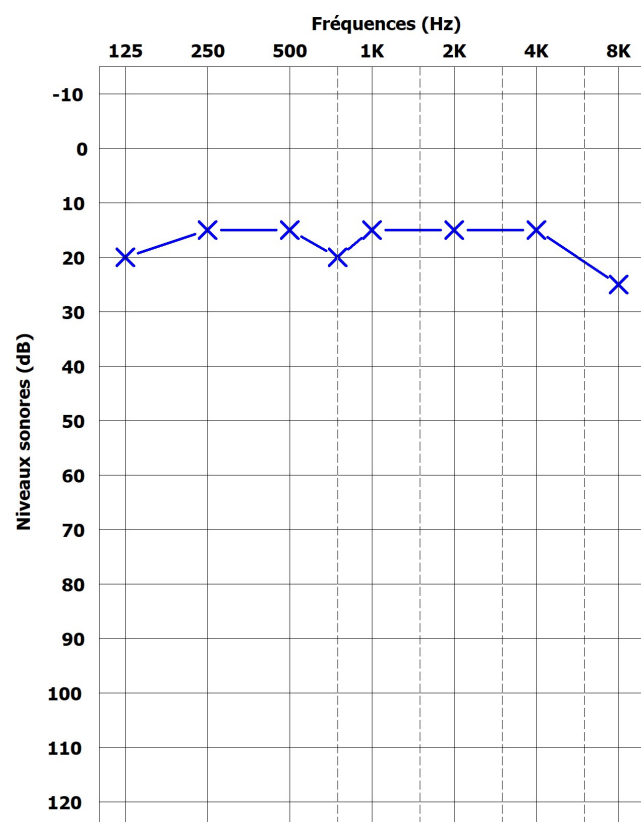

Oreille Gauche

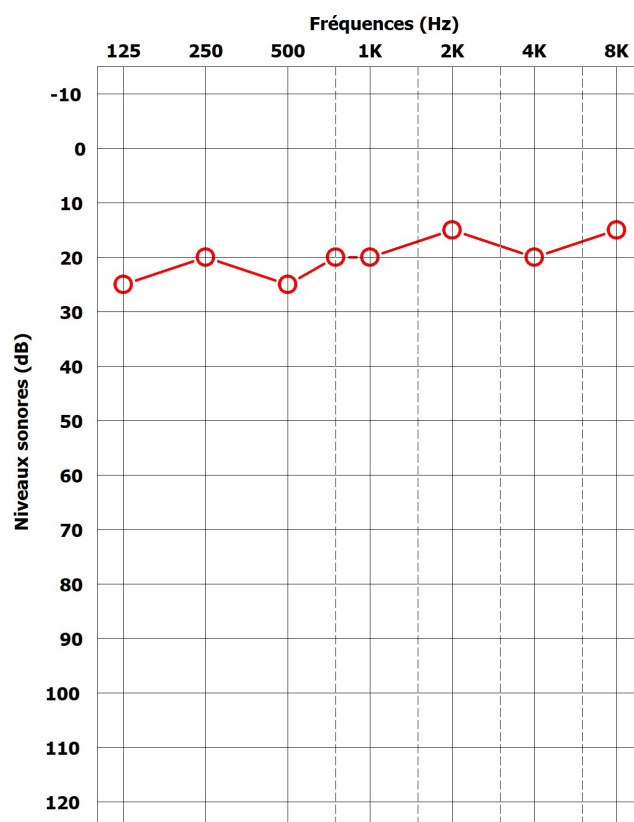

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 20  | 15  | 15  | 20  | 15 |     | 15 |    | 15 |    | 25 |
| CA Droit  | 25  | 20  | 25  | 20  | 20 |     | 15 |    | 20 |    | 15 |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 15,0 dB | --- |
| CA Droit  | 20,0 dB | --- |

Notes