


MEDVIE


Date du test: 12/03/2024 12:52:25
Durée: 2mn 49s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CONDE IBRAHIMA
Date de naissance	01/01/1997
Age	27
Société	CR18
ID	24031212301789285

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

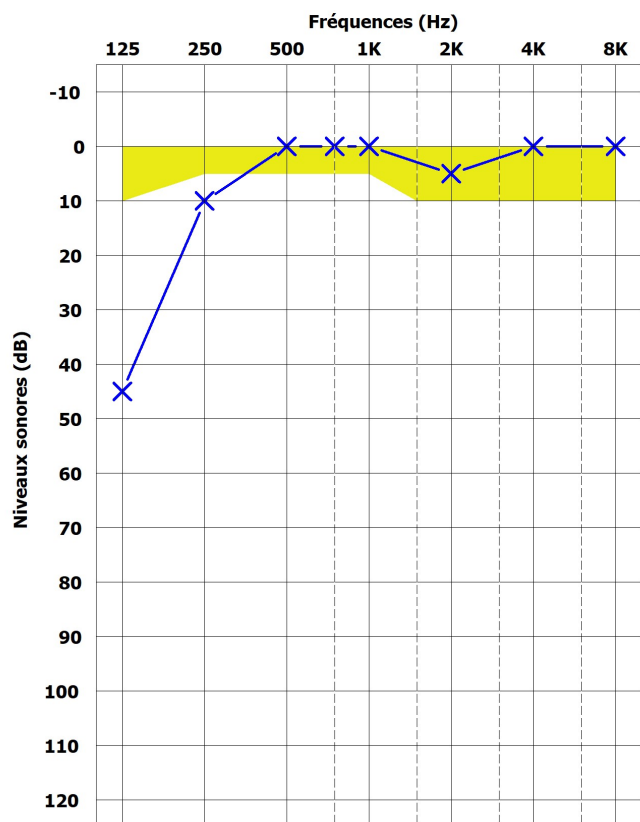

Oreille Gauche

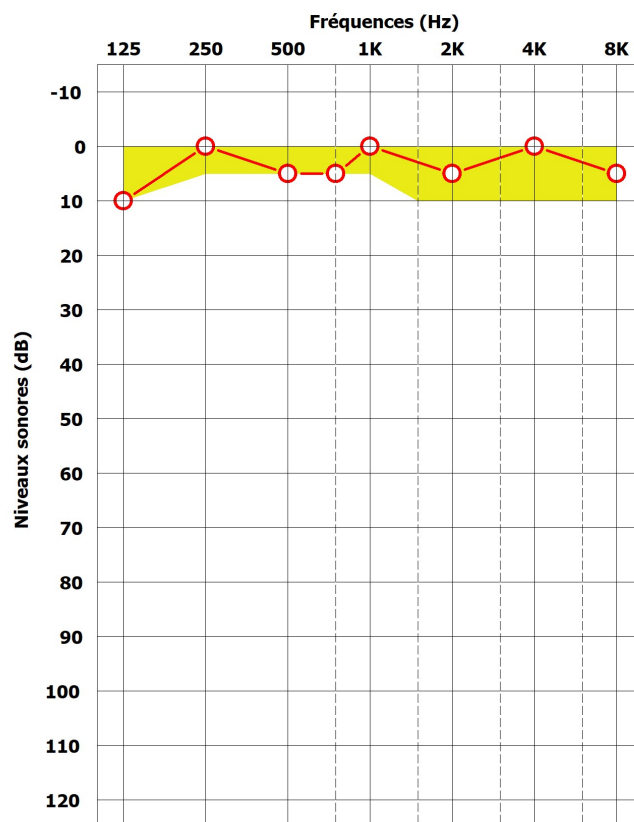

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	10	0	0	0		5		0		0
CA Droit	10	0	5	5	0		5		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes