


MEDVIE


Date du test: 15/05/2024 14:12:47
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		KONATE LAYE
Date de naissance	01/01/2002	
Age	22	
Société	CR18	
ID	24051514114072107	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

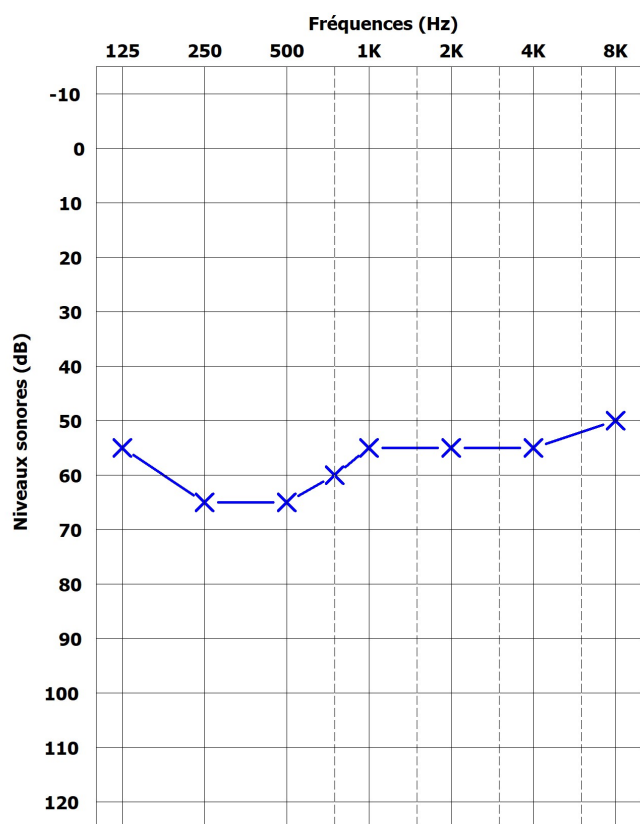

Oreille Gauche

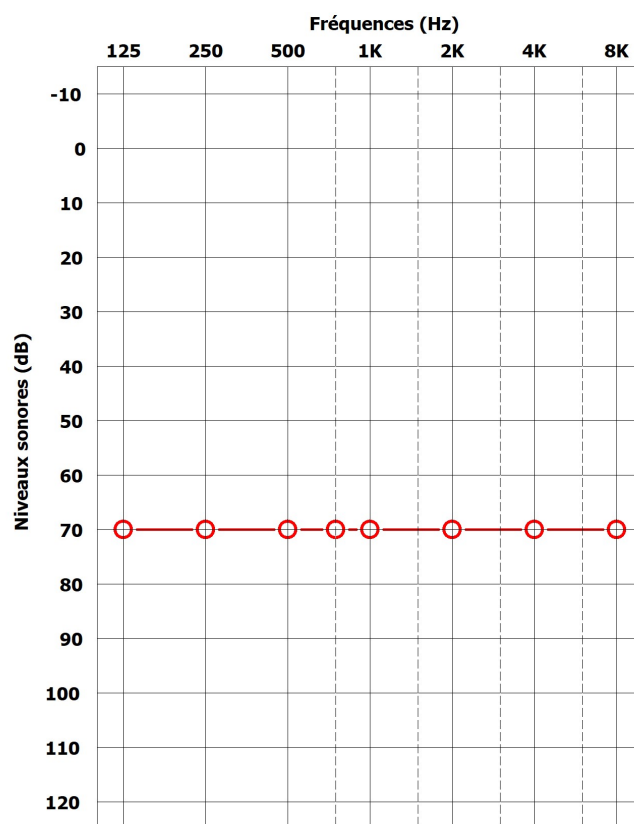

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	55	65	65	60	55		55		55		50
CA Droit	70	70	70	70	70		70		70		70

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	57,5 dB	---
CA Droit	70,0 dB	---

Notes