


MEDVIE


Date du test: 21/08/2025 18:05:02
Durée: 5mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1985
Age	40
Société	CR18
ID	25082118011672440

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

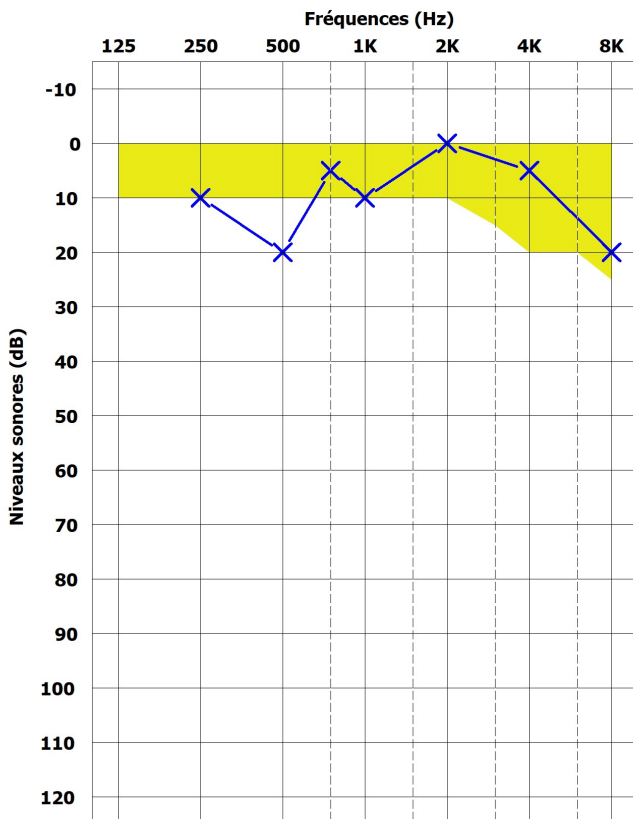

Oreille Gauche

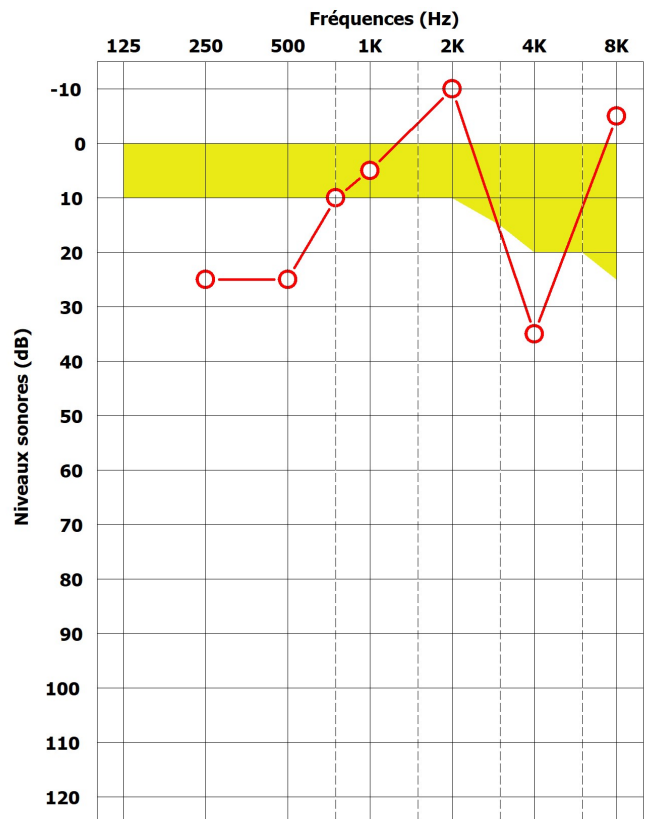

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20	5	10		0		5		20
CA Droit		25	25	10	5		-10		35		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes