

MEDVIE


Date du test: 01/07/2025 14:08:42

Durée: 4mn 16s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| YAPENG CAI        |                   |
| Date de naissance | 08/11/1985        |
| Age               | 39                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 25070114034755585 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

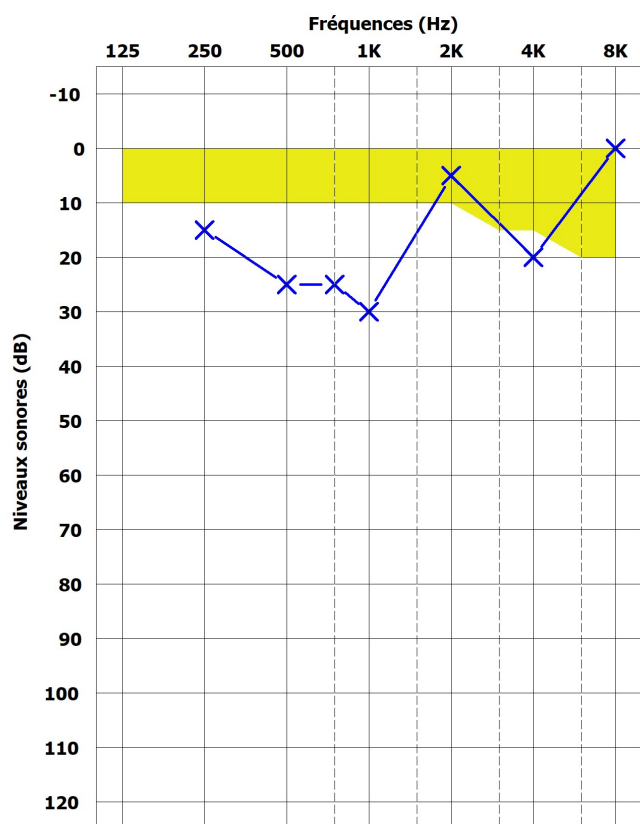

Oreille Gauche

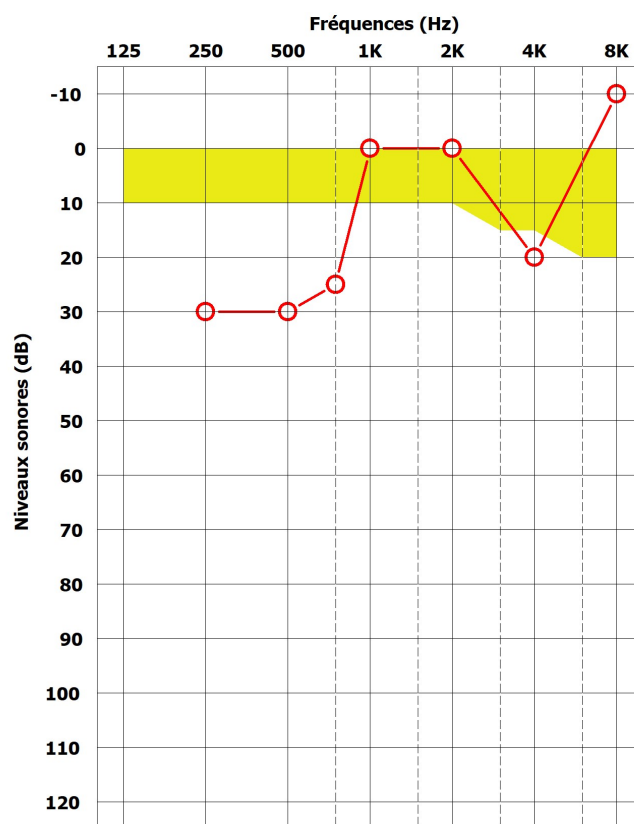

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| CA Gauche |     | 15  | 25  | 25  | 30 |     | 5  |    | 20 |    | 0   |
| CA Droit  |     | 30  | 30  | 25  | 0  |     | 0  |    | 20 |    | -10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 20,0 dB | --- |
| CA Droit        | 12,5 dB | --- |

Notes