

MEDVIE


Date du test: 14/07/2025 18:04:54

Durée: 3mn 52s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	MAMADI CAMARA
Date de naissance	08/01/1995
Age	30
Société	CR18
ID	25071418003744619

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

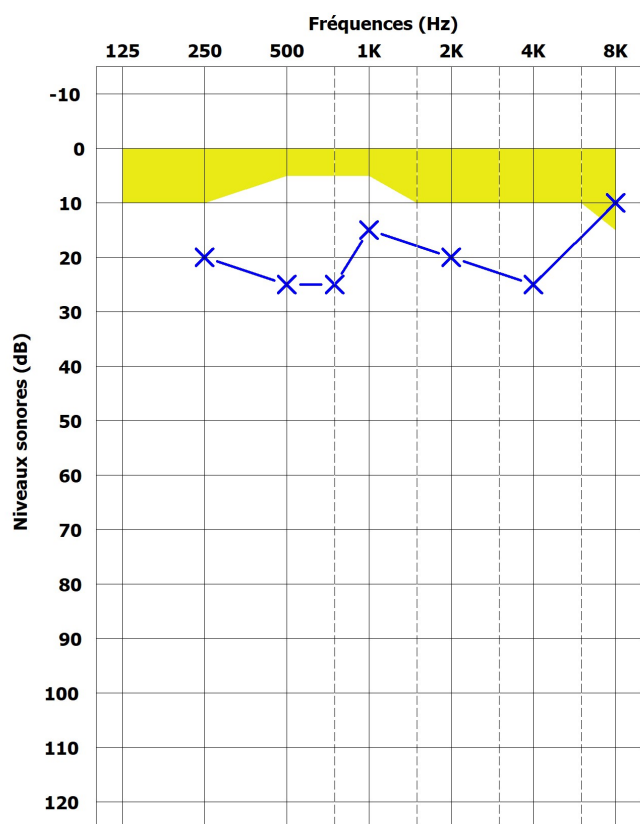

Oreille Gauche

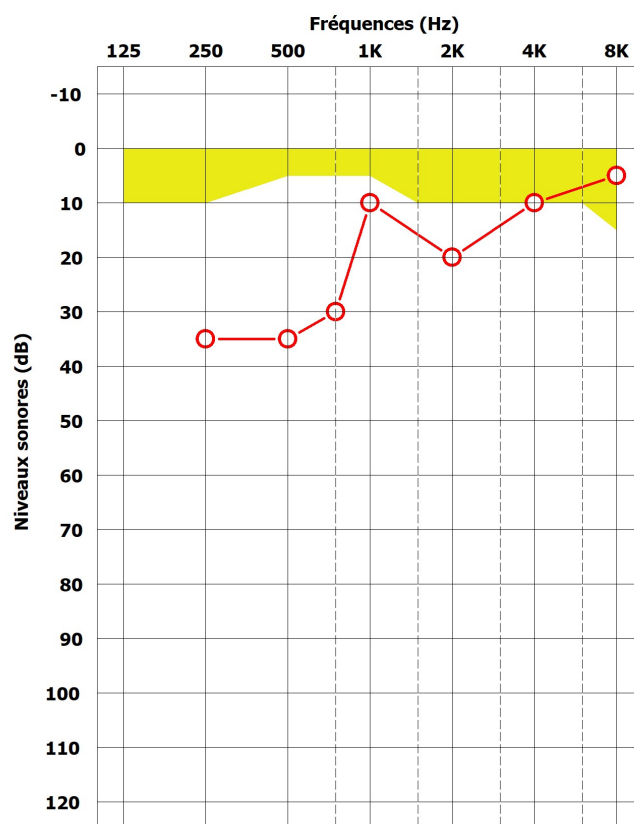

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	15		20		25		10
CA Droit		35	35	30	10		20		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes