

MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 11:58:57

Durée: 4mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SAGNO VAFING
Date de naissance	11/06/1990
Age	34
Société	CR18
ID	25031511470196319

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

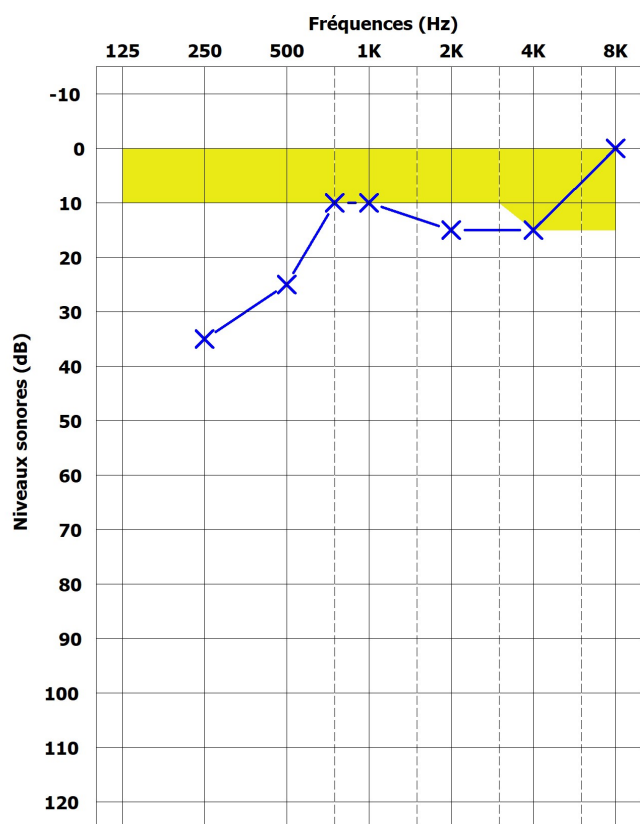

Oreille Gauche

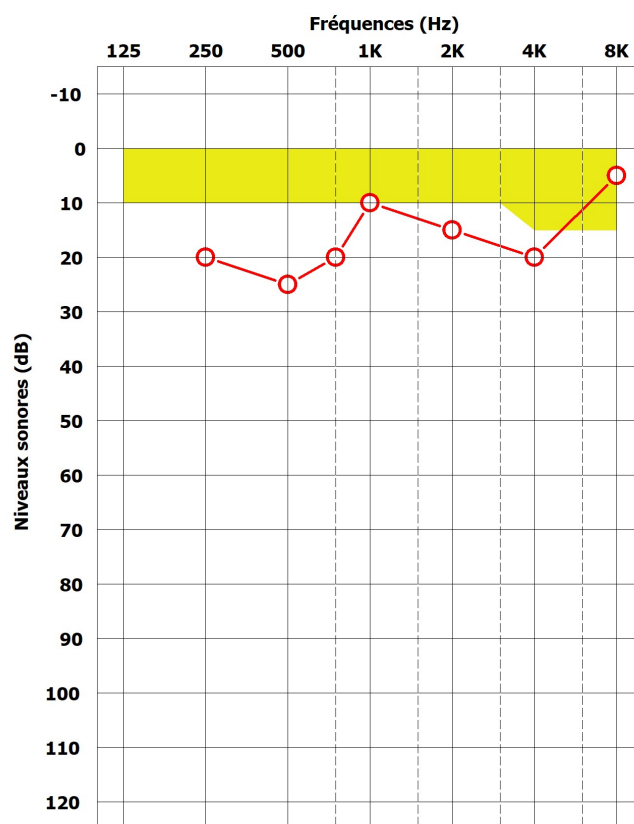

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	10	10		15		15		0
CA Droit		20	25	20	10		15		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes