


MEDVIE


Date du test: 31/05/2024 16:14:20
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient		DIOUBATE OUMAR
Date de naissance	01/01/1994	
Age	30	
Société	CR18	
ID	24053116103259455	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

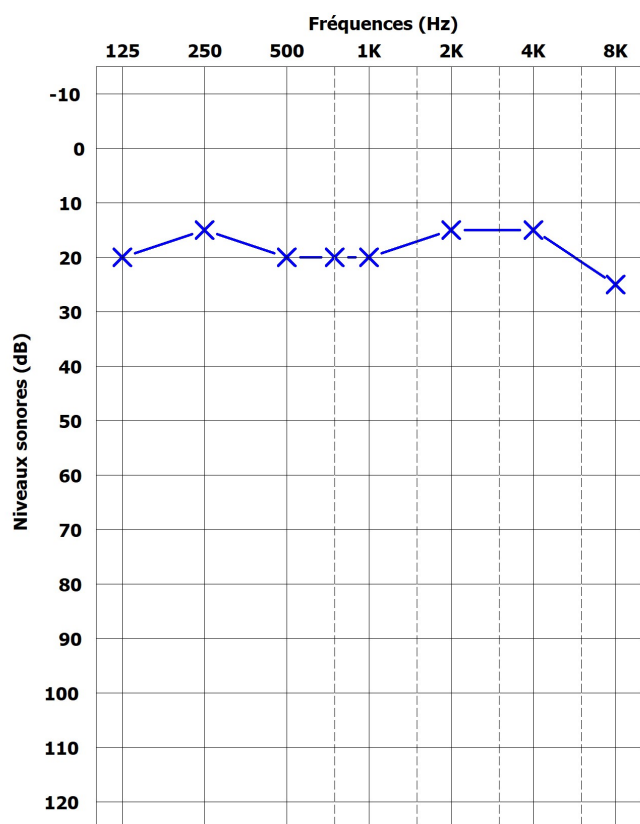

Oreille Gauche

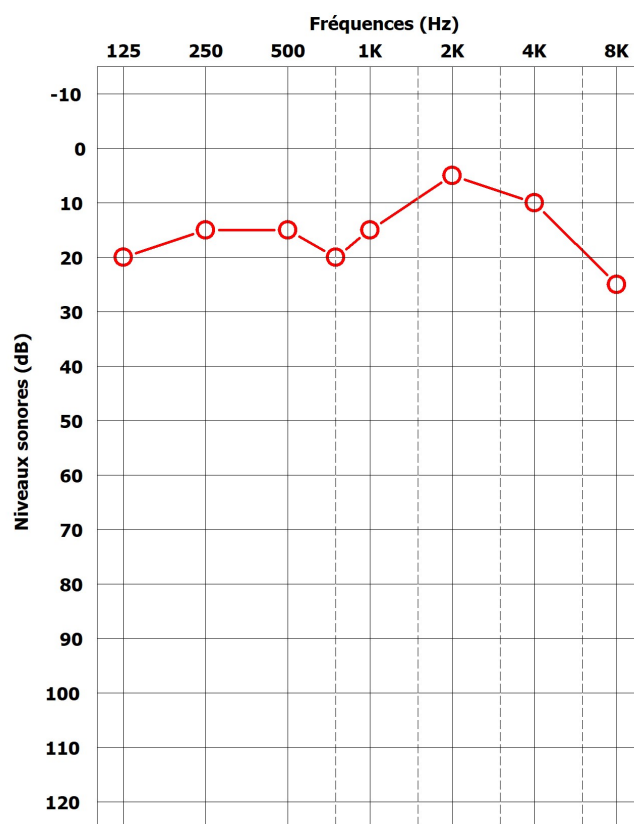

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	20	20	20		15		15		25
CA Droit	20	15	15	20	15		5		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes